DESS

> DENTAL SMART SOLUTIONS

Katalog 2024



PRODUKTLISTE


NOBELACTIVE® & NOBELREPLACE® CC 04
ACTIVE HEX


NOBEL REPLACE SELECT™ 10
TRI-LOBE


NOBEL BRÅNEMARK® 16
EXTERNAL HEX UNIVERSAL


3i OSSEOTITE® 22
EXTERNAL HEX USA


3i CERTAIN® 28
INTERNAL HEX “CLICK”


STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL & synOcta® 34
OCTAGON


STRAUMANN® BONE LEVEL 40
CONICAL BL


STRAUMANN® BLX 46
CONICAL BLX


NEODENT® GRAND MORSE 50
NEO GM


ZIMMER SCREW-VENT® 54
INTERNAL HEX USA


ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV 60
CONIC EVO


ASTRA TECH OSSEOSPEED™ 66
INTERNAL HEX CONIC


DENTSPLY FRIADENT XIVE® 72
INTERNAL HEX FD


DENTSPLY ANKYLOS® C/X 78
INTERNAL ANK


OSSTEM® TS 82
CONIC OSS


CAMLOG® 86
INTERNAL CAM


CONELOG® 90
INTERNAL CON


BIOHORIZONS® INTERNAL 94
INTERNAL HEX BH


BIOHORIZONS® EXTERNAL 98
EXTERNAL HEX BH


MIS® SEVEN 102
INTERNAL HEX MI


MIS® C1 108
CONIC MC


MIS® V3 110
CONIC MV


MEGAGEN AnyRidge® 112
CONIC ANYR


Anthogyr AXIOM® BL 116
CONIC AXIO


MEDENTIS ICX® 118
CONIC IC


GLOBALD IN-KONE® 122
CONIC INK


DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® 124
CONIC DENT


BEGO SEMADOS® 128
INTERNAL SEM


BIOTECH KONTACT® 130
CONIC BIO



BTI® 132
INTERNAL BT


PHIBO® TSH® 134
EXTERNAL HEX PH


MULTI-UNIT VERBINDUNG 136


OVERDENTURE SYSTEMS 140
DESSLoc® & DESS CLEAN FIT


VORGEFRÄSTE ROHLINGE & HALTER 144


WERKZEUGE 146


SCHRAUBEN FÜR BAUWERKE UND EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT 150

ACTIVE HEX

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

NobelActive® / Replace® CC



GINGIVAFORMER

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 3,0mm[A]	20.068/3*	20.039/3	20.040/3	20.069/3*
GH 3,0mm[B]		20.047/3	20.048/3	20.070/3*
GH 4,0mm[A]	20.068/4*	20.039/4	20.040/4	20.069/4*
GH 4,0mm[B]		20.047/4	20.048/4	20.070/4*
GH 5,0mm[A]	20.068/5*	20.039/5	20.040/5	20.069/5*
GH 5,0mm[B]		20.047/5	20.048/5	20.070/5*

[A] für Einzelzahnversorgung

[B] für Brücken und Stege



SCAN ABUTMENTS

	52.068	52.041	52.042	52.069



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.




ABFORMPFOSTEN


	17.068	17.044	17.045	17.069

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).

* *OHNE FDA*



Plattform Farbkodierung



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.068/D	14.041/D	14.042/D	14.069/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

LABORANALOGE

	14.068	14.041	14.042	14.069
10 Pack.		14.041-P10	14.042-P10	14.069-P10



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.068*	24.041	24.042	24.069*
⬡	25.068*	25.041	25.042	25.069*



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.039/1	88.040/1
GH 2,0mm	88.039/2	88.040/2
GH 3,0mm	88.039/3	88.040/3
GH 4,0mm	88.039/4	88.040/4

* *NICHT FDA*





MULTI-UNIT ABUTMENTS

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 1,5mm	0°		40.007/1	40.008/1	
GH 2,5mm	0°		40.007/2	40.008/2	
GH 3,5mm	0°		40.007/3	40.008/3	
GH 4,5mm	0°			40.008/4	
GH 2,5mm	17°		41.707/2	41.708/2	
GH 3,5mm	17°		41.707/3	41.708/3	
GH 3,5mm	30°		43.007/3	43.008/3	
GH 4,5mm	30°		43.007/4	43.008/4	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM





NEU

MUA+

GH 1,5mm	0°	42.404/1	42.405/1
GH 2,5mm	0°	42.404/2	42.405/2
GH 3,5mm	0°	42.404/3	42.405/3
GH 4,5mm	0°		42.405/4
GH 2,5mm	17°	46.404/2	46.405/2
GH 3,5mm	17°	46.404/3	46.405/3
GH 3,5mm	30°	47.404/3	47.405/3
GH 4,5mm	30°	47.404/4	47.405/4

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM




TITANBASEN

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 1,2mm	○			15.042	
GH 1,5mm	○	NEU 15.468	NEU 15.441		15.069
GH 2,0mm	○			15.042/2	
GH 3,0mm	○			15.342	
GH 1,2mm	⬡			16.042	
GH 1,5mm	⬡	NEU 16.468	NEU 16.441		16.069
GH 2,0mm	⬡			16.042/2	
GH 3,0mm	⬡			16.342	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5




ANGLEBase®

	○	36.041	36.042
	⬡	37.041	37.042

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®




5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



A B

ELLIPTIBase®

A corner	⬡	56.068
B flat	⬡	57.068



C-Base®		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 0,8mm	○		58.041	58.042	
GH 3,0mm	○		58.041/3	58.042/3	
GH 0,8mm	⬡		59.041	59.042	
GH 3,0mm	⬡		59.041/3	59.042/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase® & ELLIPTIBase® & ASC BLANK				
(Ersatzschraube)	19.468	19.441	19.442	
Empfohlenes Drehmoment	*15 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*	




Torx® BALL SCHRAUBENDREHER	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS			
0°	13.041	13.042	
15°	22.041*	22.042*	
25°		23.042*	





ABUTMENTSCHRAUBEN UG				
	19.068	19.027	19.030	19.030
10 Pack.		19.027-P10	19.030-P10	19.030-P10
DLC	19.268*	19.227	19.230	19.230
TiN	19.668*	19.627*	19.630*	19.630*
Empfohlenes Drehmoment	*15 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
Ø 10mm	Ti	61.068	61.041	61.042	61.069
Ø 14mm	Ti		62.041	62.042	62.069
Ø 14mm	CoCr		71.041		71.069



A B

NEU

ASC BLANK					
Ø 10mm	Ti	A corner	⬡	61.349*	
Ø 10mm	Ti	B flat	⬡	71.349*	
Ø 14mm	Ti	A corner	⬡		61.341* 61.342*
Ø 14mm	Ti	B flat	⬡		71.341* 71.342*



KOBALT-CHROM-BASEN		
○	30.041	30.042
⬡	31.041	31.042



KUNSTSTOFFZYLINDER		
○	28.041	28.042
⬡	29.041	29.042

TRI-LOBE

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

NobelReplace Select™



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP	6.0
	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 3,0mm	20.004/3	20.005/3	20.006/3	
GH 4,0mm	20.004/4	20.005/4	20.006/4	
GH 5,0mm	20.004/5	20.005/5	20.006/5	



SCAN ABUTMENTS

	52.004	52.005	52.006	52.097



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.004	17.005	17.006	17.097

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.004/D	14.005/D	14.006/D	14.097/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	NP	RP	WP	6.0
	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	14.004	14.005	14.006	14.097
10 Pack.	14.004-P10	14.005-P10		



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.004	24.005	24.006
◁	25.004	25.005	25.006



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.004/1	88.005/1
GH 2,0mm	88.004/2	88.005/2
GH 3,0mm	88.004/3	88.005/3
GH 4,0mm	88.004/4	88.005/4





MULTI-UNIT ABUTMENTS

			NP	RP	WP	6.0
			NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 1,0mm	0°	○	40.004/1	40.005/1	40.006/1	
GH 2,0mm	0°	○	40.004/2	40.005/2	40.006/2	
GH 3,0mm	0°	○	40.004/3	40.005/3	40.006/3	
GH 4,0mm	0°	○		40.005/4		
GH 5,0mm	0°	○		40.005/5		
GH 2,0mm	17°	◁	41.704/2*	41.705/2*		
GH 3,0mm	17°	◁	41.704/3*	41.705/3*		
GH 4,0mm	17°	◁		41.705/4*		
GH 4,0mm	30°	◁		43.005/4*		
GH 5,0mm	30°	◁		43.005/5*		
GH 5,0mm	30°	○		43.005/5R*		

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM



TITANBASEN


		NP	RP	WP	6.0
		NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 0,3mm	○	15.004	15.005	15.006	15.097
GH 1,5mm	○	15.204	15.205	15.206	
GH 3,0mm	○	15.304	15.305	15.306	
GH 0,3mm	◁	16.004	16.005	16.006	16.097
GH 1,5mm	◁	16.204	16.205		
GH 3,0mm	◁	16.304	16.305		



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	◁	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5

* NICHT FDA




ANGLEBase®

		NP	RP	WP	6.0
		NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	○	36.004	36.005	36.006	
	◁	37.004	37.005	37.006	



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5	
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5	
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5	



C-Base®

		NP	RP	WP	6.0
		NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 0,4mm	○	58.004		58.006	58.097
GH 0,5mm	○		58.005		
GH 1,5mm	○	58.004/2	58.005/2	58.006/2	
GH 3,0mm	○	58.004/3	58.005/3	58.006/3	
GH 0,4mm	◁	59.004		59.006	59.097
GH 0,5mm	◁		59.005		
GH 1,5mm	◁	59.004/2	59.005/2	59.006/2	
GH 3,0mm	◁	59.004/3	59.005/3	59.006/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.404	19.405	19.405
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*



Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06




TITANABUTMENTS

	NP	RP	WP	6.0
	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
0°	13.004	13.005	13.006	
15°	22.004*	22.005*	22.006*	
25°		23.005*		



ABUTMENTSCHRAUBEN UG

	19.004	19.005	19.005	19.005
10 Pack.	19.004-P10	19.005-P10	19.005-P10	19.005-P10
DLC	19.204	19.205	19.205	19.205
TiN	19.604*	19.605*	19.605*	19.605*
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE



Ø 10mm	Ti	61.004	61.005	61.006	61.097
Ø 14mm	Ti		62.005	62.006	62.097
Ø 14mm	CoCr	71.004	71.005	71.006	71.097

KOBALT-CHROM-BASEN



○	30.004	30.005	30.006
◁	31.004	31.005	31.006

KUNSTSTOFFZYLINDER



○	28.004	28.005	28.006
◁	29.004	29.005	29.006

 * NICHT FDA

“Großartige Dinge werden durch eine Reihe von kleineren Dingen erreicht, die zusammenkommen.”

Ein Unternehmen ohne Qualität wird nicht überleben. Terrats Medical befindet sich in der dritten Generation und wir wollen unser Erbe mit den höchsten Qualitätsanforderungen in allem, was wir tun, ehren.



EXTERNAL HEX UNIVERSAL

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Nobel Brånemark®



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 3,0mm	20.001/3	20.002/3	20.003/3
GH 4,0mm	20.001/4	20.002/4	20.003/4
GH 5,0mm	20.001/5	20.002/5	20.003/5



SCAN ABUTMENTS

	52.001	52.002	52.003



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.




ABFORMPFOSTEN

	17.041	17.042	17.043

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	NP	RP	WP
	NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.001/D	14.002/D	14.003/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

LABORANALOGE

	14.001	14.002	14.003
10 Pack.		14.002-P10	



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.001	24.002	24.003
⬡	25.001	25.002	25.003



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.001/1	88.002/1
GH 2,0mm	88.001/2	88.002/2
GH 3,0mm	88.001/3	88.002/3
GH 4,0mm		88.002/4
GH 5,0mm		88.002/5





MULTI-UNIT ABUTMENTS

			NP	RP	WP
			NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 1,0mm	0°	○	40.001/1	40.002/1	40.003/1
GH 2,0mm	0°	○	40.001/2	40.002/2	40.003/2
GH 3,0mm	0°	○	40.001/3	40.002/3	40.003/3
GH 4,0mm	0°	○		40.002/4	
GH 5,0mm	0°	○		40.002/5	
GH 2,0mm	17°	⬡	41.701/2*	41.702/2*	
GH 3,0mm	17°	⬡	41.701/3*	41.702/3*	
GH 4,0mm	17°	⬡		41.702/4*	
GH 4,0mm	30°	⬡		43.002/4*	
GH 5,0mm	30°	⬡		43.002/5*	

4.8 | 6.5
MULTI-UNIT PLATTFORM



TITANBASEN

		NP	RP	WP
GH 0,3mm	○	15.001	15.002	15.003
GH 1,5mm	○	15.201	15.202	15.203
GH 3,0mm	○	15.301	15.302	15.303
GH 0,3mm	⬡	16.001	16.002	16.003
GH 1,5mm	⬡	16.201	16.202	16.203
GH 3,0mm	⬡	16.301	16.302	16.303



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.003-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.003-P5

* NICHT FDA



ANGLEBase®

		NP	RP	WP
		NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 0,3mm	○	36.001	36.002	
GH 1,5mm	○	36.001/2	36.002/2	
GH 2,5mm	○	36.001/3	36.002/3	
GH 0,3mm	⬡	37.001	37.002	
GH 1,5mm	⬡	37.001/2	37.002/2	
GH 2,5mm	⬡	37.001/3	37.002/3	

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®

GH 1,5mm	○	58.001/2	58.002/2
GH 3,0mm	○	58.001/3	58.002/3
GH 0,6mm	⬡	59.001	59.002
GH 1,5mm	⬡	59.001/2	59.002/2
GH 3,0mm	⬡	59.001/3	59.002/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.401	19.402
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*



Torx® BALL SCHRAUBENDREHER


20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS		NP	RP	WP
		NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
	0°	13.001	13.002	13.003
	15°	22.001*	22.002*	22.003*
	25°		23.002*	



ABUTMENTSCHRAUBEN UG				
		19.027	19.028	19.029
	10 Pack.	19.027-P10	19.028-P10	
	DLC	19.227	19.228	19.229
	TiN	19.627*	19.628*	19.629*
Empfohlenes Drehmoment		*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE				
Ø 10mm	Ti	61.001	61.002	61.003
Ø 14mm	CoCr	71.001	71.002	71.003



KOBALT-CHROM-BASEN				
	○	30.001	30.002	30.003
	⬡	31.001	31.002	31.003



FÜR SCHWEISSTECHNIKEN				
	○		30.102*	




KUNSTSTOFFZYLINDER				
	○	28.001	28.002	28.003
	⬡	29.001	29.002	29.003

** NICHT FDA*

“Der Unterschied zwischen etwas Gutem und etwas Außergewöhnlichem liegt im kleinsten Detail”.

Wir bei DESS® glauben, dass kein Detail zu klein ist, um nicht beachtet zu werden. Deshalb sorgen unsere umfassenden Qualitätskontrollen in jedem einzelnen Teil des Herstellungsprozesses dafür, dass die Qualität unserer Produkte garantiert ist. Unser Vertrauen ist so groß, dass wir auf alle unsere Produkte eine lebenslange Garantie gewähren.

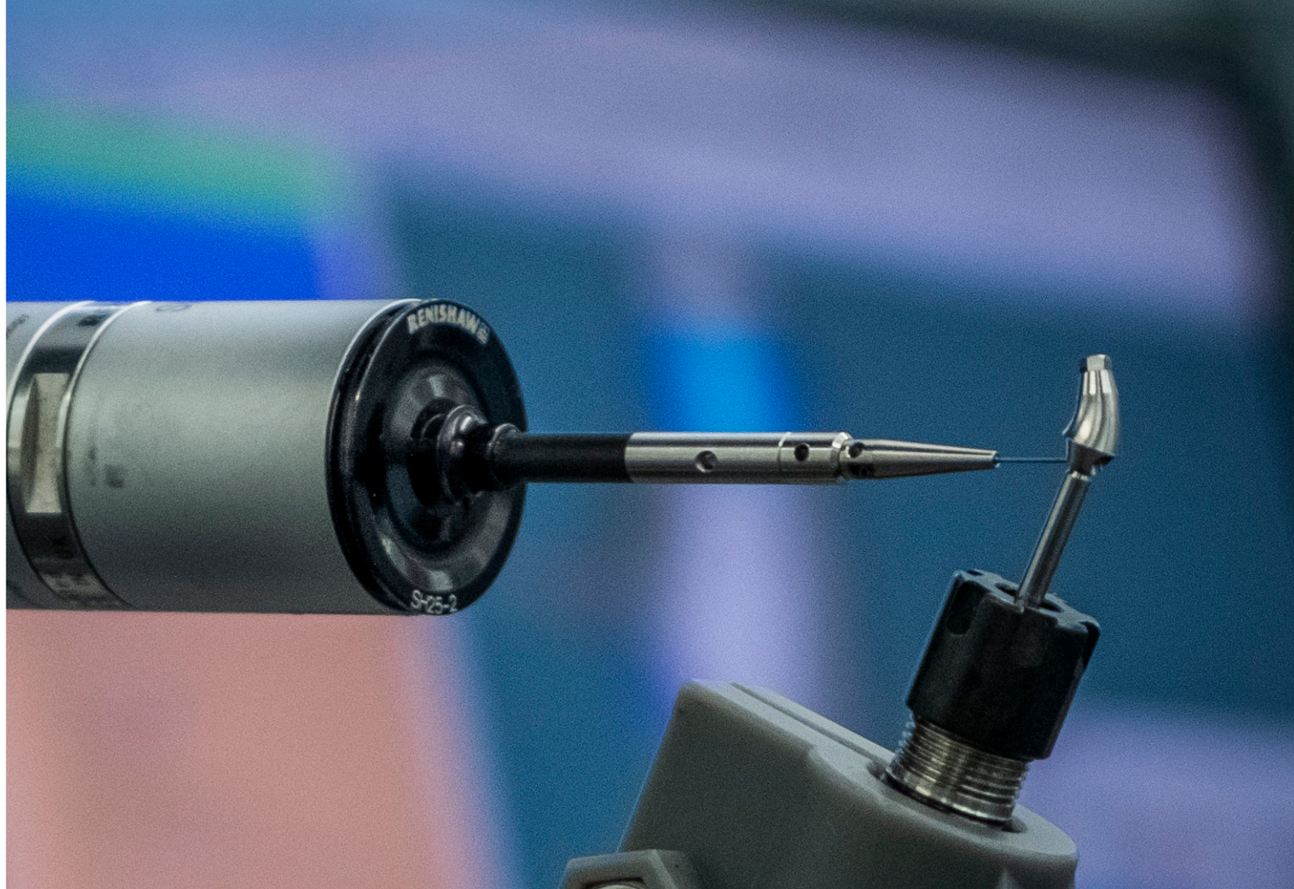

EXTERNAL HEX USA

kompatibel mit

3i® Osseotite®

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
GH 3,0mm	20.011/3	20.012/3	20.013/3
GH 4,0mm	20.011/4	20.012/4	20.013/4
GH 5,0mm	20.011/5	20.012/5	20.013/5



SCAN ABUTMENTS

	52.011	52.012	52.013



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.011	17.012	17.013

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.011/D	14.012/D	14.013/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung


LABORANALOGE

	14.011	14.012	14.013
10 Pack.		14.012-P10	



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

	24.011	24.012	24.013
⬡	25.011	25.012	25.013



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.011/1	88.012/1	88.013/1
GH 2,0mm	88.011/2	88.012/2	88.013/2
GH 3,0mm	88.011/3	88.012/3	88.013/3
GH 4,0mm	88.011/4	88.012/4	88.013/4
GH 5,0mm	88.011/5	88.012/5	88.013/5
GH 6,0mm	88.011/6 *FDA & Canada only*		88.013/6 *FDA & Canada only*



MULTI-UNIT ABUTMENTS

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
GH 1,0mm	0°	○	40.009/1	40.017/1	
GH 2,0mm	0°	○	40.009/2	40.017/2	
GH 3,0mm	0°	○	40.009/3	40.017/3	
GH 4,0mm	0°	○		40.017/4	
GH 5,0mm	0°	○		40.017/5	
GH 2,0mm	17°	⬡		41.712/2	
GH 3,0mm	17°	⬡		41.712/3	
GH 4,0mm	17°	⬡		41.712/4	
GH 3,0mm	30°	⬡		43.012/3	
GH 4,0mm	30°	⬡		43.012/4	
GH 5,0mm	30°	⬡		43.012/5	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM





TITANBASEN

GH 0,3mm		○	15.011	15.012	15.013
GH 1,5mm		○	15.211	15.212	15.213
GH 3,0mm		○	15.311	15.312	15.313
GH 0,3mm		⬡	16.011	16.012	16.013
GH 1,5mm		⬡	16.211	16.212	16.213
GH 3,0mm		⬡	16.311	16.312	16.313
KUNSTSTOFFZYLINDER					
5 Pack.		○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.		⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5






ANGLEBase®

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
GH 0,3mm		○	36.011	36.012	36.013
GH 1,5mm		○	36.011/2	36.012/2	
GH 2,5mm		○	36.011/3	36.012/3	
GH 0,3mm		⬡	37.011	37.012	37.013
GH 1,5mm		⬡	37.011/2	37.012/2	
GH 2,5mm		⬡	37.011/3	37.012/3	
KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®					
5 Pack.	0°		33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°		33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°		33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5





C-Base®

GH 1,5mm		○	58.011/2	58.012/2	58.013/2
GH 3,0mm		○	58.011/3	58.012/3	58.013/3
GH 0,6mm		⬡	59.011	59.012	59.013
GH 1,5mm		⬡	59.011/2	59.012/2	59.013/2
GH 3,0mm		⬡	59.011/3	59.012/3	59.013/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.402	19.402	19.402
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*




Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
	0°	13.011	13.012	13.013
	15°	22.011*	22.012*	22.013*
	25°		23.012*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,20mm				
		19.034	19.034	19.034
	10 Pack.	19.034-P10	19.034-P10	19.034-P10
	TiN	19.634*	19.634*	19.634*
Empfohlenes Drehmoment		*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE				
Ø 10mm	Ti	61.011	61.012	61.013
Ø 14mm	CoCr	71.011	71.012	71.013



KOBALT-CHROM-BASEN				
	○	30.011	30.012	30.013
	⬡	31.011	31.012	31.013



KUNSTSTOFFZYLINDER				
	○	28.011	28.012	28.013
	⬡	29.011	29.012	29.013

** NICHT FDA*

“Es gibt keine gute Idee, die nicht verbessert werden kann”

Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass Innovation und Qualität im Mittelpunkt unserer Grundwerte stehen. Wir prüfen verschiedene Lösungen und entwickeln sie weiter, um bessere und zuverlässigere Alternativen anzubieten. Produkte wie unser Intraoral-Scan-Abutment ohne Schraubenloch, das die Bildpräzision erheblich verbessert, unser abgewinkeltes Multi-Unit-Abutment mit einer vollständig geformten Verbindung und vertikalem Zugang für mehr Stabilität und weniger Schraubenlockerung, oder unsere abgewinkelte Schraubenkanallösung ANGLEBase®, die Ihnen einen 25°-Winkel mit einer 360°-Drehung ermöglicht, sind klare Beispiele für unsere Arbeitsweise.



INTERNAL HEX “CLICK”

kompatibel mit

3i Certain®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
GH 3,0mm	20.014/3	20.015/3	20.016/3
GH 4,0mm	20.014/4	20.015/4	20.016/4
GH 5,0mm	20.014/5	20.015/5	20.016/5



SCAN ABUTMENTS

	52.014	52.015	52.016



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.




ABFORMPFOSTEN

	17.014	17.015	17.016

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.014/D	14.015/D	14.016/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

LABORANALOGE

	14.014	14.015	14.016
10 Pack.		14.015-P10	



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.014	24.015	24.016
⬡	25.014	25.015	25.016



DESSLoc®


GH 1,0mm	88.014/1	88.015/1	88.016/1
GH 2,0mm	88.014/2	88.015/2	88.016/2
GH 3,0mm	88.014/3	88.015/3	88.016/3
GH 4,0mm	88.014/4	88.015/4	88.016/4
GH 5,0mm	88.014/5	88.015/5	88.016/5
GH 6,0mm	88.014/6 *FDA & Canada only*	88.015/6 *FDA & Canada only*	88.016/6 *FDA & Canada only*



TITANBASEN

		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
GH 0,3mm	○	15.014	15.015	15.016
GH 1,5mm	○	15.214	15.215	15.216
GH 3,0mm	○	15.314	15.315	15.316
GH 0,3mm	⬡	16.014	16.015	16.016
GH 1,5mm	⬡	16.214	16.215	16.216
GH 3,0mm	⬡	16.314	16.315	16.316
KUNSTSTOFFZYLINDER				
5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5





ANGLEBase®

	○	36.014	36.015	36.016
	⬡	37.014	37.015	37.016
KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®				
5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5





C-Base®

		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
GH 0,4mm	○	58.014	58.015	
GH 0,5mm	○			58.016
GH 1,5mm	○	58.014/2	58.015/2	58.016/2
GH 3,0mm	○	58.014/3	58.015/3	58.016/3
GH 0,4mm	⬡	59.014	59.015	
GH 0,5mm	⬡			59.016
GH 1,5mm	⬡	59.014/2	59.015/2	59.016/2
GH 3,0mm	⬡	59.014/3	59.015/3	59.016/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.

Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

	NP	RP	WP
(Ersatzschraube)	19.438	19.438	19.438
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*




Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS

	NP	RP	WP
0°	13.014	13.015	13.016
15°	22.014*	22.015*	22.016*
25°		23.015*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,20mm	NP 3.4	RP 4.1	WP 5.0
	19.011	19.011	19.011
10 Pack.	19.011-P10	19.011-P10	19.011-P10
TiN	19.611*	19.611*	19.611*
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE				
Ø 10mm	Ti	61.014	61.015	61.016
Ø 14mm	Ti		62.015	62.016
Ø 14mm	CoCr			71.016



KOBALT-CHROM-BASEN			
○	30.014	30.015	30.016
⬡	31.014	31.015	31.016



KUNSTSTOFFZYLINDER			
○	28.014	28.015	28.016
⬡	29.014	29.015	29.016

* *NICHT FDA*

CONICAL BLT IMPLANT

Das erste Zero-Waste-Implantat auf dem Markt

The Zero Waste Implant



OCTAGON

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Straumann® Tissue level & synOcta®





GINGIVAFORMER

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 2,0mm		20.009/2	20.045/2
GH 3,0mm		20.009/3	20.045/3
GH 4,0mm		20.009/4	20.045/4
Auf Abutment		20.010	20.049



KONVERTER ABUTMENT

○		35.001	
⬡		34.001	34.002



SCAN ABUTMENTS

		52.070	52.009	52.045
Auf Abutment			52.010	52.048




EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.





Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.070/D	14.009/D	14.045/D
Auf Abutment		14.010/D	14.046/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.070	14.009	14.045
10 Pack.		14.009-P10	
Auf Abutment		14.010	14.046



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○		24.026	24.045
⬡		25.009	25.045
Auf Abutment	○	24.010	24.047
	⬡	25.026	25.047




DESSLoc®

	NNC 3.5	RN 4.1/4.8	WN 4.8/6.5
GH 1,0mm		88.009/1	
GH 2,0mm		88.009/2	
GH 3,0mm		88.009/3	
GH 4,0mm		88.009/4	




TITANBASEN

		NNC 3.5	RN 4.1/4.8	WN 4.8/6.5
GH 0,3mm	◯			15.045
GH 0,4mm	◯		15.046	
GH 0,5mm	◯	15.070		
GH 0,3mm	⬡			16.045
GH 0,4mm	⬡		16.009	
GH 0,5mm	⬡	16.070		



KUNSTSTOFFZYLINDER

			NNC 3.5	RN 4.1/4.8	WN 4.8/6.5
	5 Pack.	◯	32.001-P5	32.046-P5	32.045-P5
	5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.009-P5	33.045-P5
Auf Abutment	5 Pack.	◯		32.010-P5	32.045-P5
	5 Pack.	⬡		33.010-P5	33.045-P5



ANGLEBase®

		NNC 3.5	RN 4.1/4.8	WN 4.8/6.5
	◯		36.046	36.047
	⬡		37.009	37.045



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

			NNC 3.5	RN 4.1/4.8	WN 4.8/6.5
	5 Pack.	0°		33.200-P5	33.300-P5
	5 Pack.	10°		33.201-P5	33.301-P5
	5 Pack.	20°		33.202-P5	33.302-P5




C-Base®

		NNC 3.5	RN 4.1/4.8	WN 4.8/6.5
GH 1,0mm	◯		58.009	
GH 1,2mm	◯			58.045
GH 1,0mm	⬡		59.009	
GH 1,2mm	⬡			59.045

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



A B

ELLIPTIBase®

A corner	◇	56.070
B flat	▯	57.070



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase® & ELLIPTIBase®

(Ersatzschraube)	19.441	19.446	19.446
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*	*36 Ncm*



Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
0°		13.009	
15°		22.009*	
25°		23.009*	

*inc.captive ABUTMENTSCHRAUBEN



ABUTMENTSCHRAUBEN TORX®

		NNC	RN	WN
		19.070	19.026	19.026
10 Pack.			19.026-P10	19.026-P10
TiN		19.670*	19.626*	19.626*
Empfohlenes Drehmoment		*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*
Auf Abutment			19.009	19.009
	TiN		19.609*	19.609*
Empfohlenes Drehmoment			*15 Ncm*	*15 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

		NNC	RN	WN
Ø 10mm	Ti	61.070	61.009	61.045
Ø 14mm	Ti		62.009	62.045
Ø 14mm	CoCr	71.070		





KOBALT-CHROM-BASEN

		NNC	RN	WN
		3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	○		30.009	30.045
	⬡		31.009	31.045
Für schweisstechniken	○		30.109*	30.145*
	⬡		31.109*	31.145*
Auf Abutment	○		30.010	30.048
	⬡		31.010	31.048
Für schweisstechniken	○		30.110*	



KUNSTSTOFFZYLINDER

	○		28.045
	⬡	29.009	29.045
Auf Abutment	○	28.010	28.046
Auf Abutment	⬡	29.010	29.046

CONICAL BL

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Straumann® Bone level



GINGIVAFORMER	NP NC/3.3	RP RC/4.1-4.8	NP/RP NC/RC
GH 3,0mm	20.041/3	20.042/3	
GH 4,0mm	20.041/4	20.042/4	
GH 5,0mm	20.041/5	20.042/5	



SCAN ABUTMENTS

	52.043	52.044	
Auf Abutment SRA			52.098



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.046	17.047

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE	NP NC/3.3	RP RC/4.1-4.8	NP/RP NC/RC
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.043/D	14.044/D	
AUF SRA			14.098/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

LABORANALOGE

		14.043	14.044	
	10 Pack.	14.043-P10	14.044-P10	
AUF SRA	4,6 Ø			14.098



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

	○	24.043	24.044*	
	⬡	25.043	25.044	
Auf Abutment SRA	○			24.098
	⬡			25.098



DESSLoc®

GH 1,0mm		88.042/1
GH 2,0mm	88.041/2	88.042/2
GH 3,0mm	88.041/3	88.042/3
GH 4,0mm	88.041/4	88.042/4





MULTI-UNIT ABUTMENTS

			NP	RP	NP/RP
			NC/3.3	RC/4.1-4.8	NC/RC
GH 1,5mm	0°	○	40.043/1	40.044/1	
GH 2,5mm	0°	○	40.043/2	40.044/2	
GH 3,5mm	0°	○	40.043/3	40.044/3	
GH 4,5mm	0°	○		40.044/4	
GH 2,5mm	17°	⬡	41.743/2	41.744/2	
GH 3,5mm	17°	⬡	41.743/3	41.744/3	
GH 3,5mm	30°	⬡	43.043/3	43.044/3	
GH 4,5mm	30°	⬡	43.043/4	43.044/4	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM





A B

NEU

MUA+

				NP	RP
				NC/3.3	RC/4.1-4.8
	GH 1,5mm	0°	○	42.443/1	42.444/1
	GH 2,5mm	0°	○	42.443/2	42.444/2
	GH 3,5mm	0°	○	42.443/3	42.444/3
	GH 4,5mm	0°	○		42.444/4
A corner	GH 2,5mm	17°	⬡	46.443/2	46.444/2
B flat	GH 2,5mm	17°	⬡	46.491/2*	46.492/2*
A corner	GH 3,5mm	17°	⬡	46.443/3	46.444/3
B flat	GH 3,5mm	17°	⬡	46.491/3*	46.492/3*
A corner	GH 3,5mm	30°	⬡	47.443/3	47.444/3
B flat	GH 3,5mm	30°	⬡	47.491/3*	47.492/3*
A corner	GH 4,5mm	30°	⬡	47.443/4	47.444/4
B flat	GH 4,5mm	30°	⬡	47.491/4*	47.492/4*

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM



TITANBASEN


			NP	RP	NP/RP
			NC/3.3	RC/4.1-4.8	NC/RC
GH 1,2mm		○		15.044	
GH 1,5mm		○	NEU 15.443		
GH 2,0mm		○		15.044/2	
GH 3,0mm		○		15.344	
GH 1,2mm		⬡		16.044	
GH 1,5mm		⬡	NEU 16.443		
GH 2,0mm		⬡		16.044/2	
GH 3,0mm		⬡		16.344	
ON SRA		○			15.098
		⬡			16.098





KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.		○	32.001-P5
5 Pack.		⬡	33.001-P5
ON SRA	4,6 Ø / 5 Pack.	○	32.098-P5
	5 Pack.	⬡	33.098-P5



ANGLEBase®

		NP	RP
		NC/3.3	RC/4.1-4.8
	○	36.043	36.044
	⬡	37.043	37.044



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®




5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	

C-Base®

		NP	RP	
		NC/3.3	RC/4.1-4.8	NC/RC
GH 0,7mm	○	58.043*	58.044	
GH 3,0mm	○	58.043/3	58.044/3	
GH 0,7mm	⬡	59.043	59.044	
GH 3,0mm	⬡	59.043/3	59.044/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



A B

ELLIPTIBase®		NP NC/3.3	RP RC/4.1-4.8	NP/RP NC/RC
A corner		56.043		
B flat		57.043		



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase® & ELLIPTIBase® & ASC BLANK		
(Ersatzschraube)	19.443	19.443
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*



Torx® BALL SCHRAUBENDREHER	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS			
0°	13.043	13.044	
15°	22.043*	22.044*	



ABUTMENTSCHRAUBEN TORX®				
		19.032	19.033	19.037
10 Pack.		19.032-P10	19.033-P10	19.037-P10
TiN		19.632*	19.633*	19.637*
Empfohlenes Drehmoment		*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*
Auf Abutment SRA	4,6 Ø			19.098
10 Pack.				19.098-P10
TiN				19.698*
Empfohlenes Drehmoment				*15 Ncm*





VORGEFRÄSTE ROHLINGE		NP NC/3.3	RP RC/4.1-4.8	NP/RP NC/RC
Ø 10mm	Ti	61.043	61.044	
Ø 14mm	Ti	62.043	62.044	
Ø 14mm	CoCr		71.044	



A B

NEU

ASC BLANK			NP NC/3.3	RP RC/4.1-4.8	NP/RP NC/RC
Ø 14mm	Ti	A corner	61.343*	61.344*	
Ø 14mm	Ti	B flat	71.343*	71.344*	



KOBALT-CHROM-BASEN			
	30.043	30.044	
	31.043	31.044	
Auf Abutment SRA			30.098*
			31.098*



KUNSTSTOFFZYLINDER			
	28.043	28.044	
	29.043	29.044	

CONICAL BLX

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Straumann® BLX



A B

GINGIVAFORMER

	RB/WB 3.5	WB 4.5
GH 0,8mm [A/B]		20.463/1
GH 1,5mm [A]	20.461/2	20.461/2
GH 1,5mm [B]	20.462/2	20.462/2
GH 1,5mm [A/B]		20.463/2
GH 2,5mm [A]	20.461/3	20.461/3
GH 2,5mm [B]	20.462/3	20.462/3
GH 3,5mm [A]	20.461/4	20.461/4
GH 3,5mm [B]	20.462/4	20.462/4

[A]für Einzelzahnversorgung [B]für Brücken und Steges



SCAN ABUTMENTS

		RB/WB	WB
		52.062	52.062



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	RB/WB	WB
	17.062	17.062

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	RB/WB 3.5	WB 4.5
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.062/D	14.063/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	RB/WB 3.5	WB 4.5
	14.062	14.063





MULTI-UNIT ABUTMENTS

			RB/WB 3.5	WB 4.5
GH 1,5mm	0°	○	40.062/1	40.062/1
GH 2,5mm	0°	○	40.062/2	40.062/2
GH 3,5mm	0°	○	40.062/3	40.062/3
GH 2,5mm	17°	⬡	41.762/2	41.762/2
GH 3,5mm	17°	⬡	41.762/3	41.762/3
GH 3,5mm	30°	⬡	43.062/3	43.062/3
GH 4,5mm	30°	⬡	43.062/4	43.062/4

4.8 MULTI-UNIT PLATTFORM



TITANBASEN

		RB/WB 3.5	WB 4.5
GH 0,8mm	○		15.063
GH 1,5mm	○	NEU 15.462	15.063/2
GH 0,8mm	⬡		16.063
GH 1,5mm	⬡	NEU 16.462	16.063/2



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

GH 1,5mm	○	36.062	36.063
GH 1,5mm	⬡	37.062	37.063

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

		RB/WB 3.5	WB 4.5
(Ersatzschraube)		19.441	19.441
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN TORX®

		19.054	19.054
TiN		19.700*	19.700*
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*	



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.062	
Ø 14mm	Ti		62.063
Ø 14mm	CoCr		71.063

NEO GM

kompatibel mit

Neodent® Grand Morse

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	GM
	52.035

EXTISA Extender für 52.xxx.

52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	GM
	17.035

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	GM
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.035/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*




Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	GM
	14.035






NEU

MUA+

			GM
GH 0,8mm	0°	○	42.435/1
GH 1,5mm	0°	○	42.435/2
GH 2,5mm	0°	○	42.435/3
GH 3,5mm	0°	○	42.435/4
GH 1,5mm	17°	⬡	46.435/2
GH 2,5mm	17°	⬡	46.435/3
GH 1,5mm	30°	⬡	47.435/3
GH 2,5mm	30°	⬡	47.435/4





MULTI-UNIT ABUTMENTS

			GM
GH 1,5mm	0°	○	40.035/1
GH 2,5mm	0°	○	40.035/2
GH 3,5mm	0°	○	40.035/3
GH 2,5mm	17°	⬡	41.735/2
GH 3,5mm	17°	⬡	41.735/3
GH 3,5mm	30°	⬡	43.035/3
GH 4,5mm	30°	⬡	43.035/4




NEU

TITANBASEN

		GM
GH 1,5mm	○	15.455
GH 1,5mm	⬡	16.455

GM



ANGLEBase®

GH 2,5mm	◯	36.035/3
GH 2,5mm	⬡	37.035/3

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.444
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN NEO

	19.051
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*




VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.035
Ø 14mm	Ti	62.035
Ø 14mm	CoCr	71.035

ACTIVE HEX® IMPLANT

Das erste Zero-Waste-Implantat auf dem Markt

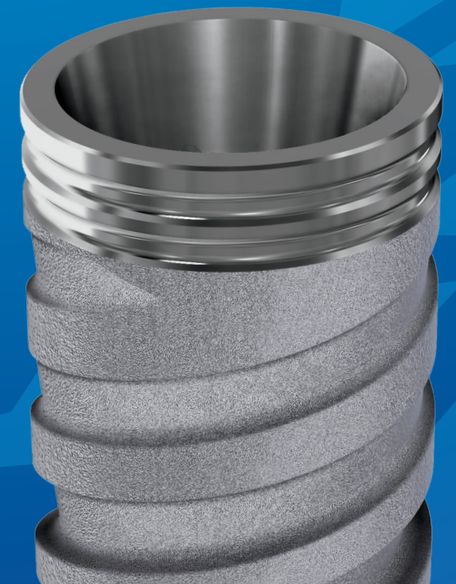

The Zero Waste Implant



INTERNAL HEX USA

kompatibel mit

Zimmer Screw-Vent®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
GH 3,0mm	20.017/3	20.018/3	20.019/3
GH 4,0mm	20.017/4	20.018/4	20.019/4
GH 5,0mm	20.017/5	20.018/5	20.019/5



SCAN ABUTMENTS

	52.017	52.018	52.019



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.017	17.018	17.019

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.017/D	14.018/D	14.019/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.017	14.018	14.019
10 Pack.	14.017-P10	14.018-P10	



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

		NP	RP	WP
		3.5	4.5	5.7
○		24.017	24.018	24.019
⬡		25.017	25.018	25.019



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.017/1	88.018/1	88.019/1
GH 2,5mm	88.017/2	88.018/2	88.019/2
GH 3,5mm	88.017/3	88.018/3	88.019/3
GH 4,5mm	88.017/4	88.018/4	88.019/4
GH 5,5mm	88.017/5	88.018/5	88.019/5
GH 6,5mm	88.017/6 *FDA & Canada only*	88.018/6 *FDA & Canada only*	88.019/6 *FDA & Canada only*





MULTI-UNIT ABUTMENTS

GH 1,0mm	0°	○	40.019/1	40.020/1
GH 2,0mm	0°	○	40.019/2	40.020/2
GH 3,0mm	0°	○	40.019/3	40.020/3
GH 4,0mm	0°	○	40.019/4	40.020/4
GH 5,0mm	0°	○	40.019/5	40.020/5
GH 2,5mm	17°	⬡	41.719/2	41.720/2
GH 3,5mm	17°	⬡	41.719/3	41.720/3
GH 3,5mm	30°	⬡	43.019/3	43.020/3
GH 4,5mm	30°	⬡	43.019/4	43.020/4

4.8 MULTI-UNIT PLATTFORM




TITANBASEN

		NP	RP	WP
		3.5	4.5	5.7
GH 0,3mm	○		15.018	15.019
GH 1,5mm	○	NEU 15.430	15.218	15.219
GH 3,0mm	○		15.318	15.319
GH 0,3mm	⬡		16.018	16.019
GH 1,5mm	⬡	NEU 16.430	16.218	16.219
GH 3,0mm	⬡		16.318	16.319



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5




ANGLEBase®

		NP	RP	WP
	○	36.017	36.018	36.019
	⬡	37.017	37.018	37.019

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5




C-Base®

		NP	RP	WP
		3.5	4.5	5.7
GH 0,5mm	○	58.017	58.018	58.019
GH 1,5mm	○	58.017/2	58.018/2	58.019/2
GH 3,0mm	○	58.017/3	58.018/3	58.019/3
GH 0,5mm	⬡	59.017	59.018	59.019
GH 1,5mm	⬡	59.017/2	59.018/2	59.019/2
GH 3,0mm	⬡	59.017/3	59.018/3	59.019/2

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



A B

ELLIPTIBase®

A corner	◇	56.017
B flat	▭	57.017




Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase® & ELLIPTIBase®

(Ersatzschraube)	19.417	19.417	19.417
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*




Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS

0°	13.017	13.018	13.019
15°	22.017*	22.018*	22.019*
25°	23.017*	23.018*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
	19.042	19.042	19.042
10 Pack.	19.042-P10	19.042-P10	19.042-P10
TiN	19.642*	19.642*	19.642*
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.017	61.018	61.019
Ø 14mm	Ti	62.017	62.018	62.019
Ø 14mm	CoCr	71.017	71.018	71.019



KOBALT-CHROM-BASEN

○	30.017	30.018	30.019
⬡	31.017	31.018	31.019



KUNSTSTOFFZYLINDER

○	28.017 *19.012*	28.018 *19.012*	28.019 *19.012*
10 Pack.		11.018-P10	
⬡	29.017 *19.012*	29.018 *19.012*	29.019 *19.012*
10 Pack.	12.017-P10	12.018-P10	

* *NICHT FDA*

ANGLEBase®

ANGLEBase® ist unsere Lösung für klinische Situationen, in denen die lange Achse des Implantats zu einer ungünstigen Lage des Zugangslochs für die Prothetikschraube führt.

1. 25° maximale Abwinkelung.
2. 360° Freiheit.
3. SelectGrip®.
4. Titan Grad V.



CONIC EVO

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Astra Tech implant system™ EV



GINGIVAFORMER

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
GH 3,5mm	20.406/3	20.059/3	20.060/3	20.061/3	20.407/3
GH 4,5mm	20.406/4	20.059/4	20.060/4	20.061/4	20.407/4
GH 6,5mm	20.406/6	20.059/6	20.060/6	20.061/6	20.407/6



SCAN ABUTMENTS

		52.406	52.059	52.060	52.061	52.407
Auf Uniabutment®	52.058					



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

		17.406	17.059	17.060	17.061	17.407
Auf Uniabutment®	17.058					

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.406/D	14.059/D	14.060/D	14.061/D	14.407/D
Auf Uniabutment® 14.058/D					

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

		14.406	14.059	14.060	14.061	14.407
Auf Uniabutment®	14.058					



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○		24.406	24.059	24.060	24.061	24.407
⬡		25.406	25.059	25.060	25.061	25.407
Auf Uniabutment®	○	24.058				



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.059/1	88.060/1	88.061/1
GH 2,0mm	88.059/2	88.060/2	88.061/2
GH 3,0mm	88.059/3	88.060/3	88.061/3
GH 4,0mm	88.059/4	88.060/4	88.061/4



UNIABUTMENT®

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
GH 1,0mm		40.059/1	40.060/1	40.061/1	
GH 2,0mm		40.059/2	40.060/2	40.061/2	
GH 3,0mm		40.059/3	40.060/3	40.061/3	
GH 5,0mm		40.059/5	40.060/5	40.061/5	

UniAbutment® benötigt einen 1,75 mm Hex Schraubendreher





MULTI-UNIT ABUTMENTS

			EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
GH 1,5mm	0°	○	40.406/1	40.027/1	40.036/1	40.037/1	40.407/1
GH 2,5mm	0°	○	40.406/2	40.027/2	40.036/2	40.037/2	40.407/2
GH 3,5mm	0°	○	40.406/3	40.027/3	40.036/3	40.037/3	40.407/3
GH 3,5mm	17°	⬡		41.727/3	41.736/3	41.737/3	
GH 4,5mm	17°	⬡		41.727/4	41.736/4	41.737/4	
GH 4,5mm	30°	⬡		43.027/4	43.036/4	43.037/4	
GH 5,5mm	30°	⬡		43.027/5	43.036/5	43.037/5	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM






TITANBASEN

				EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
GH 1,0mm		○		15.059	15.060	15.061	15.407	
GH 1,5mm		○	NEU 15.406					
GH 3,0mm		○		15.359	15.360	15.361		
GH 1,0mm		⬡		16.059	16.060	16.061	16.407	
GH 1,5mm		⬡	NEU 16.406					
GH 3,0mm		⬡		16.359	16.360	16.361		
Auf Uniabutment®		○	15.058					



KUNSTSTOFFZYLINDER

			EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
5 Pack.		○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	
5 Pack.		⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	
Auf Uniabutment®	5 Pack.	○	32.001-P5				



ANGLEBase®

			EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
		○		36.059	36.060	36.061	
		⬡		37.059	37.060	37.061	
Auf Uniabutment®		○	36.058				

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



			EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
5 Pack.	0°			33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5	
5 Pack.	10°			33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5	
5 Pack.	20°			33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5	
Auf Uniabutment®							
5 Pack.	0°	33.100-P5					
5 Pack.	10°	33.101-P5					
5 Pack.	20°	33.102-P5					




C-Base®

			EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
GH 1,0mm		○		58.059	58.060	58.061	
GH 3,0mm		○		58.059/3	58.060/3	58.061/3	
GH 1,0mm		⬡		59.059	59.060	59.061	
GH 3,0mm		⬡		59.059/3	59.060/3	59.061/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



A B

ELLIPTIBase®

A corner	◇	56.406
B flat	▯	57.406



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

		EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
(Ersatzschraube)		19.468	19.441	19.460	19.461	
Empfohlenes Drehmoment		*15 Ncm*	*25 Ncm*	*25 Ncm*	*25 Ncm*	
Auf Uniabutment®	19.331*					
Empfohlenes Drehmoment	*15 Ncm*					




Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

		EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
		3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
		19.071	19.059	19.060	19.061	19.061
	TiN	19.671*	19.659*	19.660*	19.661*	19.661*
Empfohlenes Drehmoment			*25 Ncm*	*25 Ncm*	*24 Ncm*	
Auf Uniabutment®		19.058				
	TiN	19.658*				
Empfohlenes Drehmoment		*15 Ncm*				



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.406	61.059	61.060	61.061	61.407
Ø 14mm	Ti		62.059	62.060	62.061	62.407
Ø 14mm	CoCr		71.059	71.060	71.061	71.407



KOBALT-CHROM-BASEN

	○		30.059	30.060	30.061
	⬡		31.059	31.060	31.061
Auf Uniabutment®	○	30.058			




KUNSTSTOFFZYLINDER

	○	28.059	28.060	28.061
Auf Uniabutment®	○	28.058		

Die ultimative Multi-Unit

100% kompatibel mit dem gängigsten System auf dem Markt.

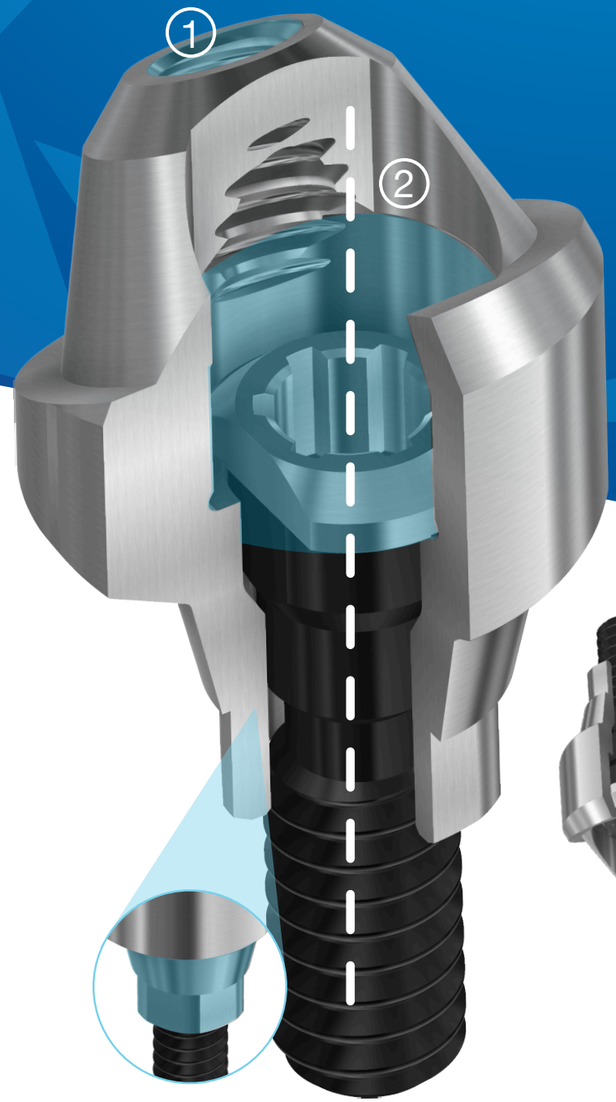

1. Ein Vollgewinde am Verbindungskonus bedeutet eine sicherere und stabilere Prothese.

2. Der vertikale Schraubenzugang erleichtert das Einsetzen und ermöglicht ein Anziehen mit einem maximalen Drehmoment von 35Ncm*, um ein Lösen der Schraube zu verhindern und die Stabilität des Multi-Unit-Aufbaus zu verbessern.

*Je nach Kompatibilität



Der Multi-Unit-Winkeltransporter wurde speziell entwickelt, um als Kontaktpunkt mit der Schraube zu dienen, damit diese nicht herausfallen kann.

INTERNAL HEX CONIC

kompatibel mit

Astra Tech Osseospeed™

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
	GH 3,0mm			20.024/3	20.025/3
	GH 4,0mm			20.024/4	20.025/4
	GH 5,0mm			20.024/5	20.025/5
Anatomic	GH 4,0mm	Ø 4,5		20.424/4	
	GH 4,0mm	Ø 5,5		20.524/4	20.525/4
	GH 4,0mm	Ø 6,5			20.625/4



SCAN ABUTMENTS

			52.023	52.024	52.025
Auf uniabutment®	20°	52.036			
	45°	52.037			



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

			17.023	17.024	17.025
Auf uniabutment®	20°	17.036			
	45°	17.037			

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*			14.023/D	14.024/D	14.025/D
Auf uniabutment®	20°	14.036/D			
	45°	14.037/D			

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

			14.023	14.024	14.025
	10 Pack.			14.024-P10	14.025-P10
Auf uniabutment®	20°	14.036			
	45°	14.037			



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

				14.023*	14.024	14.025
		○		25.023*	25.024	25.025
Auf uniabutment®	20°	○	24.028			
	45°	○	24.029			



DESSLoc®

	NP	RP	WP
	3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 1,0mm	88.023/1	88.024/1	88.025/1
GH 2,0mm	88.023/2	88.024/2	88.025/2
GH 3,0mm	88.023/3	88.024/3	88.025/3
GH 4,0mm	88.023/4	88.024/4	88.025/4



UNIABUTMENT®

GH 0,5mm	20°	40.013/0	40.015/0
GH 1,0mm	20°	40.013/1	40.015/1
GH 2,0mm	20°	40.013/2	40.015/2
GH 4,0mm	20°	40.013/4	40.015/4
GH 6,0mm	20°	40.013/6	40.015/6
GH 0,5mm	45°	40.014/0	40.016/0
GH 1,0mm	45°	40.014/1	40.016/1
GH 2,0mm	45°	40.014/2	40.016/2
GH 4,0mm	45°	40.014/4	40.016/4
GH 6,0mm	45°	40.014/6	40.016/6





MULTI-UNIT ABUTMENTS

GH 1,5mm	0°	○	40.024/1	40.025/1
GH 2,5mm	0°	○	40.024/2	40.025/2
GH 3,5mm	0°	○	40.024/3	40.025/3
GH 3,5mm	17°	○	41.724/3	41.725/3
GH 4,5mm	17°	○	41.724/4	41.725/4
GH 4,5mm	30°	○	43.024/4	43.025/4
GH 5,5mm	30°	○	43.024/5	43.025/5

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM





TITANBASEN

		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 0,9mm	○			15.025
GH 1,1mm	○		15.024	
GH 1,5mm	○	NEU 15.423		
GH 2,0mm	○		15.024/2	15.025/2
GH 3,0mm	○		15.324	15.325
GH 0,9mm	○			16.025
GH 1,1mm	○		16.024	
GH 1,5mm	○	NEU 16.423		
GH 2,0mm	○		16.024/2	16.025/2
GH 3,0mm	○		16.324	16.325

Auf uniabutment®	20° ○	15.036	
	45° ○	15.037	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	○	33.001-P5	33.001-P5

Auf uniabutment® 32.001-P5




ANGLEBase®

○	36.024	36.025
○	37.024	37.025

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®

		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 0,8mm	○		58.024	
GH 0,9mm	○			58.025
GH 3,0mm	○		58.024/3	58.025/3
GH 0,8mm	◌		59.024	
GH 0,9mm	◌			59.025
GH 3,0mm	◌		59.024/3	59.025/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.441	19.425
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*25 Ncm*




Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS

0°	○	13.024	13.025
15°	○	22.024*	22.025*
25°	○	23.024*	

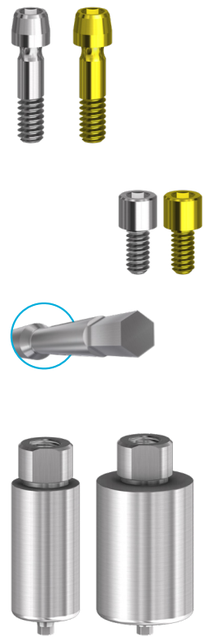

ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
Auf uniabutment®			19.015	19.016	19.017
	TiN		19.615*	19.616*	19.617*
Empfohlenes Drehmoment			*15 Ncm*	*20 Ncm*	*25 Ncm*
		19.018			
	10 Pack.	19.018-P10			
	TiN	19.618*			
Empfohlenes Drehmoment		*15 Ncm*			

VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	**Ti**	61.023	61.024	61.025
Ø 14mm	**Ti**		62.024	62.025
Ø 14mm	**CoCr**		71.024	



KOBALT-CHROM-BASEN

		○		30.024	30.025
		◌		31.024	31.025
Auf uniabutment®	20°	○	30.036		
	45°	○	30.037		



KUNSTSTOFFZYLINDER

		○		28.024	28.025
		◌		29.024	29.025
Auf uniabutment®	20°	○	28.036		
Auf uniabutment®	45°	○	28.037		

INTERNAL HEX FD

kompatibel mit Xive®

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

Der INTERNAL HEX FD-Anschluss ist erhältlich, solange der Vorrat reicht.



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP	5.5
	3.4	3.8	4.5	5.5
GH 3,0mm	20.036/3	20.037/3	20.038/3	
GH 4,0mm	20.036/4	20.037/4	20.038/4	
GH 5,0mm	20.036/5	20.037/5	20.038/5	



SCAN ABUTMENTS

⬡	52.038	52.039	52.040	52.071



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.038	17.039	17.040	17.071

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	NP	RP	WP	5.5
	3.4	3.8	4.5	5.5
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.038/D	14.039/D	14.040/D	14.071/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.038	14.039	14.040	14.071
10 Pack.		14.039-P10		



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

◯	24.038	24.039	24.040
⬡	25.038	25.039	25.040



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.036/1	88.037/1
GH 2,0mm	88.036/2	88.037/2
GH 3,0mm	88.036/3	88.037/3
GH 4,0mm	88.036/4	88.037/4



TITANBASEN

		NP	RP	WP	5.5
		3.4	3.8	4.5	5.5
GH 0,3mm	○	15.038	15.039	15.040	15.071
GH 1,5mm	○	15.238	15.239	15.240	15.271
GH 3,0mm	○	15.338	15.339	15.340	15.371
GH 0,3mm	⬡	16.038	16.039	16.040	16.071
GH 1,5mm	⬡	16.238	16.239	16.240	16.271
GH 3,0mm	⬡	16.338	16.339	16.340	16.371



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

	○	36.038	36.039	36.040
	⬡	37.038	37.039	37.040



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.100-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.100-P5	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®

		NP	RP	WP	5.5
		3.4	3.8	4.5	5.5
GH 0,3mm	○	58.038	58.039		
GH 0,6mm	○			58.040	58.071
GH 1,5mm	○	58.038/2	58.039/2	58.040/2	58.071/2
GH 3,0mm	○	58.038/3	58.039/3	58.040/3	58.071/3
GH 0,3mm	⬡	59.038	59.039		
GH 0,6mm	⬡			59.040	59.071
GH 1,5mm	⬡	59.038/2	59.039/2	59.040/2	59.071/2
GH 3,0mm	⬡	59.038/3	59.039/3	59.040/3	59.071/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.438	19.438	19.438
Empfohlenes Drehmoment	*24 Ncm*	*24 Ncm*	*24 Ncm*



Torx® BALL SCHRAUBENDREHER


20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS

0°	13.038	13.039	13.040
15°	22.038*	22.039*	22.040*
25°		23.039*	





ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm	NP	RP	WP	5.5
	3.4	3.8	4.5	5.5
	19.024	19.024	19.024	19.024
TiN	19.624*	19.624*	19.624*	19.624*
Empfohlenes Drehmoment	*24 Ncm*	*24 Ncm*	*24 Ncm*	*24 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.038	61.039	61.040	61.071
Ø 14mm	Ti		62.039	62.040	62.071
Ø 14mm	CoCr	71.038	71.039		71.071



KOBALT-CHROM-BASEN

○	30.038	30.039	30.040
⬡	31.038	31.039	31.040



KUNSTSTOFFZYLINDER

○	28.038	28.039	28.040
⬡	29.038	29.039	29.040

* NICHT FDA



DESSLoc®


Überlegene Widerstandsfähigkeit, bessere klinische Ergebnisse

Das DESS® Deckprothesensystem ist mit einer Zirkoniumnitrid-Beschichtung versehen, die eine verbesserte Festigkeit bei geringerer Plaqueanhaftung bietet, was die klinischen Ergebnisse verbessert und Zahnfleischentzündungen reduziert.

- 100% kompatibel mit den gängigen System.
- Reduziert die Plaque-Adhäsion.
- Reduziert die Entzündung der Gingiva.



Inklusive Träger für einfache Positionierung.

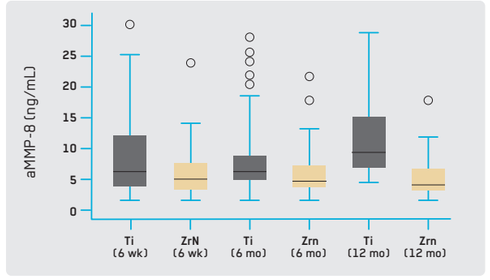

aMMP-8-Werte der periimplantären Sulkusflüssigkeit in mit Titan (Ti) und Zirkoniumnitrid (ZrN) beschichteten Attachments zu verschiedenen Zeitpunkten nach der prothetischen Versorgung. (Matrix Metalloproteinase-8 Levels in Peri-implant Sulcus Fluid Adjacent to Titanium and Zirconium NitrideSurface, Richard Meissen, MSc1 Mariana Mintcheva, MSc1 Lutz Netuschil, PhDIncludes carrier for Dr2, Int J Periodontics Restorative Dent 2014; 34:91-95. doi: 10.11607/prd.1504)

INTERNAL ANK

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Dentsply Ankylos® C/X



GINGIVAFORMER

GH 1,5mm	20.046/1
GH 2,5mm	20.046/3



SCAN ABUTMENTS

52.049



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

GH 1,5mm	17.049
GH 2,5mm	17.250

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm	Ø 3,5	14.048/D
	Ø 4,5	14.049/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

Ø 3,5	14.048
10 Pack.	14.048-P10
Ø 4,5	14.049
10 Pack.	14.049-P10



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

GH 1,5mm	○	24.048
GH 2,5mm	○	24.250
GH 1,5mm	⬡	25.048
GH 2,5mm	⬡	25.250



DESSLoc®

GH 2,0mm	88.046/2
GH 3,0mm	88.046/3
GH 4,0mm	88.046/4




TITANBASEN

GH 1,5mm	◯	15.050
GH 2,5mm	◯	15.250
GH 1,5mm	⬡	16.050
GH 2,5mm	⬡	16.250



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	◯	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



C-Base®

GH 1,4mm	◯	58.050
GH 2,5mm	◯	58.050/2
GH 1,4mm	⬡	59.050
GH 2,5mm	⬡	59.050/2

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.




Replacement ABUTMENTSCHRAUBEN for C-Base®

	19.702
Empfohlenes Drehmoment	*15 Ncm*



TITANABUTMENTS

GH 1,5mm	0°	13.047
GH 2,5mm	0°	13.250
GH 1,5mm	15°	22.048*
GH 2,5mm	15°	22.250*
GH 1,5mm	25°	23.048*
GH 2,5mm	25°	23.250*



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,00mm

GH 1,5mm	19.048
TiN	19.648*
GH 2,5mm	19.050
Empfohlenes Drehmoment	*15 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.250



KOBALT-CHROM-BASEN

GH 1,5mm	◯	30.050
GH 2,5mm	◯	30.250
GH 1,5mm	⬡	31.050
GH 2,5mm	⬡	31.250



KUNSTSTOFFZYLINDER

GH 1,5mm	◯	28.048
GH 2,5mm	◯	28.250

CONIC OSS

kompatibel mit

Osstem® TS / HIOSSEN® ET

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	Mini	Regular
	52.072	52.073



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.072	17.073

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	14.072/D	14.073/D
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*		

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.072	14.073



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

		Mini	STD
		Mini	Regular
○		24.072	24.073
⬡		25.072	25.073



MULTI-UNIT ABUTMENTS

			Mini	STD
			Mini	Regular
GH 1,5mm	0°	○	40.072/1	40.073/1
GH 2,5mm	0°	○	40.072/2	40.073/2
GH 3,5mm	0°	○	40.072/3	40.073/3
GH 2,5mm	17°	⬡	41.772/2*	41.773/2*
GH 3,5mm	17°	⬡	41.772/3*	41.773/3*
GH 3,5mm	30°	⬡	43.072/3*	43.073/3*
GH 4,5mm	30°	⬡	43.072/4*	43.073/4*

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM



TITANBASEN

GH 1,0mm	○	15.072	15.073
GH 3,0mm	○	15.372	15.373
GH 1,0mm	⬡	16.072	16.073
GH 3,0mm	⬡	16.372	16.373



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

		Mini	STD
		Mini	Regular
○		36.072	36.073
⬡		37.072	37.073

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5 / 33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5 / 33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5 / 33.102-P5



C-Base®

		Mini	STD
GH 1,0mm	○	58.072	58.073
GH 3,0mm	○	58.072/3*	58.073/3*
GH 1,0mm	⬡	59.072	59.073
GH 3,0mm	⬡	59.072/3	59.073/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

	Mini	STD
(Ersatzschraube)	19.444	19.461
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*25 Ncm*



Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

	Mini	STD
	Mini	Regular
	19.072	19.073
DLC	19.272*	19.273*
TiN	19.672*	19.673*
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*30 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.072	61.073
Ø 14mm	Ti	62.072	62.073
Ø 14mm	CoCr	71.072	



KOBALT-CHROM-BASEN

	Mini	STD
○	30.072	30.073
⬡	31.072	31.073

INTERNAL CAM

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Camlog®



GINGIVAFORMER

	3.3	3.8	4.3	5.0
	3.3	3.8	4.3	5.0
GH 3,0mm		20.065/3	20.066/3	
GH 4,0mm		20.065/4	20.066/4	
GH 5,0mm		20.065/5	20.066/5	



SCAN ABUTMENTS

52.064	52.065	52.066	52.067



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.064	17.065	17.066	17.067

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	3.3	3.8	4.3	5.0
	3.3	3.8	4.3	5.0
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.064/D	14.065/D	14.066/D	14.067/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

14.064	14.065	14.066	14.067



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.065	24.066
🔔	25.065	25.066



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.065/1	88.066/1
GH 2,0mm	88.065/2	88.066/2
GH 3,0mm	88.065/3	88.066/3
GH 4,0mm	88.065/4	88.066/4




TITANBASEN

		3.3	3.8	4.3	5.0
		3.3	3.8	4.3	5.0
GH 0,3mm	○		15.065	15.066	15.067
GH 0,5mm	○	15.064			
GH 1,5mm	○		15.265	15.266	
GH 3,0mm	○		15.365	15.366	
GH 0,3mm	🔔		16.065	16.066	16.067
GH 0,5mm	🔔	16.064			
GH 1,5mm	🔔		16.265	16.266	
GH 3,0mm	🔔		16.365	16.366	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	🔔	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

	○	36.065	36.066
	🔔	37.065	37.066

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.444	19.444
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

	3.3	3.8	4.3	5.0
	3.3	3.8	4.3	5.0
	19.044	19.044	19.044	19.045
TiN	19.644*	19.644*	19.644*	19.645*
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.064	61.065	61.066	61.067
Ø 14mm	Ti		62.065	62.066	62.067
Ø 14mm	CoCr	71.064		71.066	71.067



KOBALT-CHROM-BASEN

○	30.065	30.066
🔔	31.065	31.066



KUNSTSTOFFZYLINDER

○	28.065	28.066

INTERNAL CON

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Conelog®



SCAN ABUTMENTS

	NP	RP	WP
	3.3	3.8/4.3	5.0
	52.074	52.075	52.076



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.074	17.075	17.076

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.074/D	14.075/D	14.076/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.074	14.075	14.076



TITANBASEN

		NP	RP	WP
		3.3	3.8/4.3	5.0
GH 1,4mm	○	15.074*	15.075*	15.076*
GH 3,0mm	○	15.074/3*	15.075/3*	15.076/3*
GH 1,4mm	🔔	16.074*	16.075*	16.076*
GH 3,0mm	🔔	16.074/3*	16.075/3*	16.076/3*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	🔔	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

	○	36.074*	36.075*	36.076*
	🔔	37.074*	37.075*	37.076*

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®

		NP	RP	WP
		3.3	3.8/4.3	5.0
GH 1,0mm	○	58.074*	58.075*	58.076*
GH 2,1mm	○	58.074/2*	58.075/2*	58.076/2*
GH 1,0mm	Conelog®	59.074*	59.075*	59.076*
GH 2,1mm	Conelog®	59.074/2*	59.075/2*	59.076/2*

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Replacement ABUTMENTSCHRAUBEN for C-Base®

	19.052*	19.052*	19.053*
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.474*	19.474*	19.476*
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*



Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

	NP	RP	WP
	3.3	3.8/4.3	5.0
	19.074*	19.074*	19.076*
TiN	19.674*	19.674*	19.676*
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.074*	61.075*	61.076*
Ø 14mm	Ti	62.074*	62.075*	62.076*
Ø 14mm	CoCr	71.074*	71.075*	71.076*

INTERNAL HEX BH

kompatibel mit

BioHorizons® internal

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
GH 3,0mm		20.087/3	20.088/3	20.089/3
GH 4,0mm		20.087/4	20.088/4	20.089/4
GH 5,0mm		20.087/5	20.088/5	20.089/5



SCAN ABUTMENTS

	52.099	52.087	52.088	52.089



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.087	17.088	17.089

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.099/D	14.087/D	14.088/D	14.089/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
	14.099	14.087	14.088	14.089



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.087/1	88.088/1
GH 2,5mm	88.087/2	88.088/2
GH 3,5mm	88.087/3	88.088/3
GH 4,5mm	88.087/4	88.088/4
GH 5,5mm	88.087/5	



TITANBASEN

GH 0,3mm	○		15.088	15.089
GH 0,8mm	○	15.087		
GH 0,3mm	⬡		16.088	16.089
GH 0,8mm	⬡	16.087		



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5




MULTI-UNIT ABUTMENTS

			3.0	NP	RP	WP
			3.0	3.5	4.5	5.7
GH 1,0mm	0°	◯		40.087/1	40.088/1	
GH 2,0mm	0°	◯		40.087/2	40.088/2	
GH 3,0mm	0°	◯		40.087/3	40.088/3	
GH 4,0mm	0°	◯		40.087/4		
GH 5,0mm	0°	◯		40.087/5		
GH 2,5mm	17°	⬡		41.787/2*	41.788/2*	
GH 3,5mm	17°	⬡		41.787/3*	41.788/3*	
GH 3,5mm	30°	⬡		43.087/3*	43.088/3*	
GH 4,5mm	30°	⬡		43.087/4*	43.088/4*	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM






ANGLEBase®

		3.0	NP	RP	WP
	◯		36.087	36.088	36.089
	⬡		37.087	37.088	37.089

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®




5 Pack.	0°		33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°		33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°		33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5



A B

ELLIPTIBase®

A corner	⬡		56.099
B flat	⬡		57.099



C-Base®

			3.0	NP	RP	WP
			3.0	3.5	4.5	5.7
GH 0,5mm		◯		58.087	58.088	58.089
GH 3,0mm		◯		58.087/3	58.088/3	58.089/3
GH 0,5mm		⬡		59.087	59.088	59.089
GH 3,0mm		⬡		59.087/3	59.088/3	59.089/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.




Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase® & ELLIPTIBase®

(Ersatzschraube)	19.400	19.417	19.417	19.417
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06





ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

		19.043	19.043	19.043	19.043
	TiN	19.643*	19.643*	19.643*	19.643*
Empfohlenes Drehmoment		*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.099	61.087	61.088	61.089
Ø 14mm	Ti			62.088	62.089

EXTERNAL HEX BH

kompatibel mit

BioHorizons® External

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.7	4.2	5.2
GH 3,0mm	20.020/3*	20.021/3*	20.022/3*
GH 4,0mm	20.020/4*	20.021/4*	20.022/4*
GH 5,0mm	20.020/5*	20.021/5*	20.022/5*



SCAN ABUTMENTS

	52.020	52.021	52.022



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.020	17.021	17.022

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	NP	RP	WP
	3.7	4.2	5.2
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.020/D	14.021/D	14.022/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*





Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.020	14.021	14.022

PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.020*	24.021*	24.022*
⬡	25.020*	25.021*	25.022*



TITANBASEN

GH 0,3mm	○	15.051*	15.052*	15.053*
GH 0,3mm	⬡	16.051*	16.052*	16.053*




KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.003-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.003-P5



TITANABUTMENTS		NP	RP	WP
		3.7	4.2	5.2
	0°	13.020*	13.021*	13.022*
	15°	22.020*	22.021*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm			
	19.013*	19.014*	19.014*
10 Pack.		19.014-P10*	19.014-P10*
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE				
Ø 10mm	Ti	61.020*	61.021*	61.022*
Ø 14mm	Ti	62.020*	62.021*	62.022*
Ø 14mm	CoCr	71.020*	71.021*	71.022*



KUNSTSTOFFZYLINDER			
○	28.020	28.021	28.022
⬡	29.020	29.021	29.022

Ihr Design, unsere Präzision

PRE-MILLED

Fräsen Sie Ihr Design mit der Präzision der DESS®-Verbindungen.
Unser Angebot an vorgefrästen Rohlingen ist für die gängigsten Implantatverbindungen der Welt erhältlich.

- 32 Kompatibilitäten
- Titan Grad 5 ELI Ø 10mm 14mm
- Micromelt CoCr Ø 14mm
- Fräsbare Gesamtlänge 20mm
- Minimaler Zahnfleischübergang (0,3mm)



INTERNAL HEX MI

kompatibel mit

Mis® Seven

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	SP	WP	Multi-Unit
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
GH 3,0mm		20.095/3*	20.096/3*	
GH 4,0mm		20.095/4*	20.096/4*	
GH 5,0mm		20.095/5*	20.096/5*	



SCAN ABUTMENTS

52.056	52.095	52.096	52.085



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.




ABFORMPFOSTEN

17.056	17.095	17.096

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	NP	SP	WP	Multi-Unit
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.056/D	14.095/D	14.096/D	14.007/D [1]
				14.085/D [2]

Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159

[1] *Standard Multi-Unit* [2] *MIS® Multi-Unit*

LABORANALOGE

	14.056	14.095	14.096	14.007 [1]
				14.085 [2]
10 Pack.		14.095-P10		14.007-P10

[1] *Standard Multi-Unit* [2] *MIS® Multi-Unit*



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.095*	24.096*
⬡	25.095*	25.096*



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.095/1*	88.096/1*
GH 2,5mm	88.095/2*	88.096/2*
GH 3,5mm	88.095/3*	88.096/3*
GH 4,5mm	88.095/4*	88.096/4*
GH 5,5mm	88.095/5*	



TITANBASEN

		NP 3.3	SP 3.75-4.2	WP 5.0-6.0	Multi-Unit 4.8
GH 0,3mm	○			15.096*	15.085*
GH 0,8mm	○	15.056*	15.095*		
GH 1,5mm	○	15.256*	15.295*	15.296*	
GH 3,0mm	○	15.356*	15.395*	15.396*	
GH 0,3mm	⬡			16.096*	
GH 0,8mm	⬡	16.056*	16.095*		
GH 1,5mm	⬡	16.256*	16.295*	16.296*	
GH 3,0mm	⬡	16.356*	16.395*	16.396*	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5




MULTI-UNIT ABUTMENTS

GH 1,0mm	0°	○	40.095/1*	40.096/1*
GH 2,0mm	0°	○	40.095/2*	40.096/2*
GH 3,0mm	0°	○	40.095/3*	40.096/3*
GH 4,0mm	0°	○	40.095/4*	
GH 5,0mm	0°	○	40.095/5	
GH 2,5mm	17°	⬡	41.795/2*	41.796/2*
GH 3,5mm	17°	⬡	41.795/3*	41.796/3*
GH 3,5mm	30°	⬡	43.095/3	43.096/3
GH 4,5mm	30°	⬡	43.095/4	43.096/4



4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM



ANGLEBase®

	NP 3.3	SP 3.75-4.2	WP 5.0-6.0	Multi-Unit 4.8
○		36.095*	36.096*	
⬡		37.095*	37.096*	



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5




Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.417	19.417
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*	*30 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06






TITANABUTMENTS

0°	13.095*	13.096*
15°	22.095*	22.096*
25°	23.095*	23.096*





ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm	NP	SP	WP	Multi-Unit
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
	19.056*	19.081*	19.081*	19.110
TiN	19.656*	19.681*	19.681*	
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*
				19.085*
TiN				19.685*
Empfohlenes Drehmoment				*15 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE				
Ø 10mm	Ti	61.056*	61.095*	61.096*
Ø 14mm	CoCr			71.096*



KOBALT-CHROM-BASEN			
○	30.056*	30.095*	30.096*
⬡	31.056*	31.095*	31.096*





KUNSTSTOFFZYLINDER			
○	28.056	28.095	28.096
⬡	29.056	29.095	29.096

ELLIPTIBase


FÜR ENGE INTERDENTALRÄUME

- Bessere ästhetische Ergebnisse.
- SelectGrip® Oberflächenbehandlung.
- 22% kleiner als eine Standard-Ti-Base.
- 20° Abwinkelung.
- Beschichtung aus Zirkoniumnitrid (ZrN).

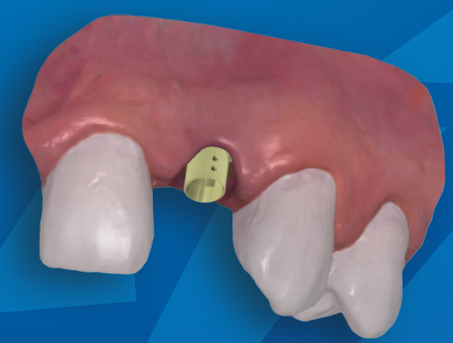

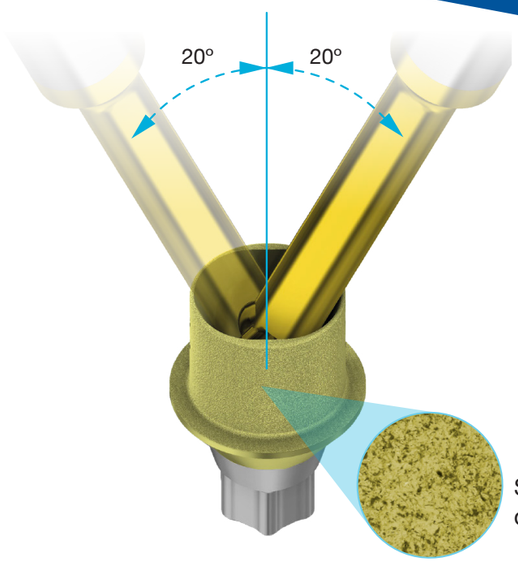

*Mikroskopische Ansicht



Die 22%ige Verkleinerung des ELLIPTIBase® Designs ermöglicht mehr Platz für die Restauration.

Select**Grip®**: Oberflächenbehandlung, die die Retention um bis zu 500 % verbessert.

CONIC MC

kompatibel mit

Mis® C1 internal

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	NP	SP	WP	Multi-Unit
				4.8
	52.081	52.082	52.083	52.085 MIS



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.081	17.082	17.083

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.081/D	14.082/D	14.083/D	14.007/D [1]
				14.085/D [2]

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

[1] *Standard Multi-Unit* [2] *MIS® Multi-Unit*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

14.081	14.082	14.083	14.007 [1]
			14.085 [2]

[1] *Standard Multi-Unit* [2] *MIS® Multi-Unit*




TITANBASEN

		NP	SP	WP	Multi-Unit
					4.8
GH 0,3mm	○				15.085* MIS
GH 1,0mm	○	15.081*	15.082*	15.083*	
GH 1,0mm	⬡	16.081*	16.082*	16.083*	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.007-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

		19.056*	19.081*	19.081*	
					19.085* MIS
TiN		19.656*	19.681*	19.681*	
TiN					19.685* MIS
Empfohlenes Drehmoment		*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*25 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.081*	61.082*	61.083*

CONIC MV

kompatibel mit

Mis® V3

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	NP	SP	Multi-Unit 4.8
	52.084	52.082	52.085



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	NP	SP
	17.084	17.082

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung


DIGITAL LABORANALOGE

	NP	SP	Multi-Unit
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.084/D	14.082/D	14.007/D [1]
			14.085/D [2]

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

[1] *Standard Multi-Unit*

[2] *MIS® Multi-Unit*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

NP	SP	Multi-Unit
14.084	14.082	14.007 [1]
		14.085 [2]

[1] *Standard Multi-Unit*

[2] *MIS® Multi-Unit*




TITANBASEN

		NP	SP	Multi-Unit 4.8
GH 0,3mm	○			15.085*
GH 1,0mm	○	15.084*	15.082*	
GH 1,0mm	⬡	16.084*	16.082*	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.007-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	

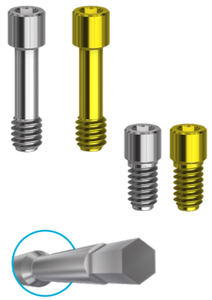

ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

		NP	SP	Multi-Unit
		19.056*	19.081*	
				19.085*
TiN		19.656*	19.681*	
TiN				19.685*
Empfohlenes Drehmoment		*30 Ncm*	*30 Ncm*	*25 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

		NP	SP
Ø 10mm	Ti	61.084*	61.082*

CONIC ANYR

kompatibel mit

Megagen AnyRidge®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

52.057



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.057

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.057/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

14.057



TITANBASEN

GH 2,0mm	○	15.057
GH 3,0mm	○	15.357
GH 2,0mm	⬡	16.057
GH 3,0mm	⬡	16.357



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5

ANGLEBase®

○	36.057
⬡	37.057

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5




Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.460
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,20mm

		19.057
	TiN	19.657*
Empfohlenes Drehmoment		*35 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.057
Ø 14mm	CoCr	71.057

periocoat® Zirkonium-Nitrid

Weniger Biofilmbildung auf der Oberfläche

Je weniger Biofilm und Plaque vorhanden sind, desto geringer sind Quantität und Qualität der Bakterien, die eine Entzündung des Weichgewebes verursachen können.

Erhöhte Kollagenstabilität

ZrN führt zu einer geringeren Entzündungsbelastung und einem geringeren Kollagenabbau im Zahnfleischgewebe, was durch einen geringeren aMMP8-Biomarker in der Zahnfleischflüssigkeit belegt wird.

Die Oberfläche ist widerstandsfähiger gegen Korrosion

Zahnbelag produziert Säure, die die Oberfläche angreift und die Rauheit erhöht. ZrN ist härter und hat einen geringeren Reibungskoeffizienten, was es korrosionsbeständiger macht.

Erhöhte Adhäsion von Fibroblasten

Eine höhere Adhäsion der Fibroblasten verschließt den Weg zwischen der Oberfläche und dem Weichgewebe und verhindert, dass Bakterien in den Zahnfleischrand eindringen können.

Sechsmal härter als Titanium Oxide


Kratzt nicht so leicht bei der Reinigung mit Küretten, Ultraschallgeräten oder anderen Instrumenten.

ZrN hat einen warmen goldenen Farbton

Ein warmer, goldfarbener Farbton hat ästhetische Vorteile gegenüber dem Titangrau.

periocoat®

- Weniger Entzündungen.
- Weniger Plaqueanhaftung.
- Höhere Korrosionsbeständigkeit.
- Leichter zu reinigen.
- 6x härter als Titanoxid.

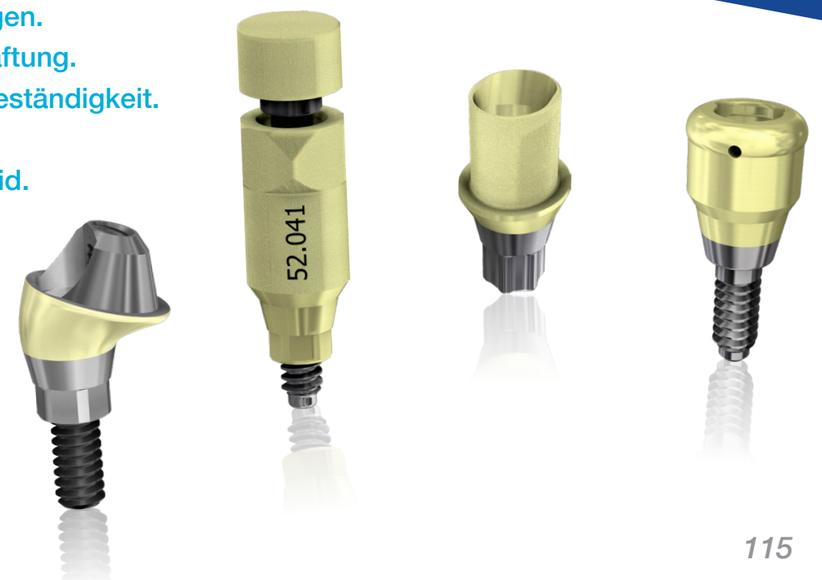

CONIC AXIO

kompatibel mit

Anthogyr AXIOM® BL

○ ohne Rotationsschutz

△ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

52.077



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.077

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.077/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

14.077



TITANBASEN




GH 2,9mm	○	15.077*
GH 2,9mm	△	16.077*

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	△	33.001-P5







ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,18mm

		19.077*
	TiN	19.677*
Empfohlenes Drehmoment		*25 Ncm*
Auf Abutment®		19.062*
	TiN	19.662*
Empfohlenes Drehmoment		*15 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.077*

CONIC IC

kompatibel mit

Medentis ICX®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

52.080



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.080

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.080/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

14.080



TITANBASEN

	○	15.080*
	⬡	16.080*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



ANGLEBase®

GH 2,2mm	○	36.080*
GH 0,9mm	○	36.180*
GH 2,2mm	⬡	37.080*
GH 0,9mm	⬡	37.180*

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)

2,2mm	19.444
0,9mm	19.443
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06





ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,40mm

		19.080*
	TiN	19.680*
Empfohlenes Drehmoment		*30 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.080*
Ø 14mm	Ti	62.080*
Ø 14mm	CoCr	71.080*

Die Bedeutung eines präzisen Bildes

Unser revolutionäres Intraoral-Scan-Abutment, das in Zusammenarbeit mit Exocad® entwickelt wurde, wurde sorgfältig entwickelt, um ein möglichst präzises Bild zu erzeugen. Das aus Titan gefertigte Intraoral-Scan-Abutment ermöglicht eine Rx-Kontrolle und verfügt über eine ZrN-Beschichtung, um den Glitzereffekt zu reduzieren.



1. KEIN SCHRAUBENLOCH
(Keine verzerrung beim scan)

2. ORIENTIERUNG AUF HÖHERER POSITION
(Maximale Sichtbarkeit)

3. HERGESTELLT AUS TITAN
(Extrem haltbar)

4. ENTHÄLT MANUELLES WERKZEUG DTPEIPEEK.



CONIC INK

kompatibel mit

GlobalD IN-KONE®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	52.086



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.086

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.086/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.086






TITANBASEN

	○	15.086*
	⬡	16.086*

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5





ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

		19.086*
TiN		19.686*
Auf Abutment©	0°	19.035*
	17° / 30°	19.036*
TiN	0°	19.635*
TiN	17° / 30°	19.636*
Empfohlenes Drehmoment		*15 Ncm*

CONIC DENT

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Dentium Superline™ & Implantium®



SCAN ABUTMENTS

RP

3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
		52.090		



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.090

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.090/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

RP

3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
		14.090		



TITANBASEN

GH 0,9mm	○	15.090*
GH 1,5mm	○	15.190* *(15.090/2*)*
GH 3,0mm	○	15.390* *(15.090/3*)*
GH 0,9mm	⬡	16.090*
GH 1,5mm	⬡	16.190* *(16.090/2*)*
GH 3,0mm	⬡	16.390* *(16.090/3*)*



KUNSTSTOFFZYLINDER


5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5





MULTI-UNIT ABUTMENTS

			RP 3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
GH 1,5mm	0°	○			40.090/1		
GH 2,5mm	0°	○			40.090/2		
GH 3,5mm	0°	○			40.090/3		
GH 2,5mm	17°	⬡			41.790/2*		
GH 3,5mm	17°	⬡			41.790/3*		
GH 2,5mm	30°	⬡			43.090/2*		
GH 3,5mm	30°	⬡			43.090/3*		



ANGLEBase®

	○	36.090*
	⬡	37.090*

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®


(Ersatzschraube)	19.405
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06







ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,28mm

		RP 3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
				19.090*		
	TiN			19.690*		
Empfohlenes Drehmoment				*30 Ncm*		
Auf Abutment®				19.066*		
	TiN			19.666*		
Empfohlenes Drehmoment				*10 Ncm*		



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.090*
Ø 14mm	Ti	62.090*
Ø 14mm	CoCr	71.090*



KOBALT-CHROM-BASEN

○	30.090*
⬡	31.090*



KUNSTSTOFFZYLINDER

○	28.090
⬡	29.090

INTERNAL SEM

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

Bego Semados®



SCAN ABUTMENTS

	3.25/3.75	4.1	4.5	5.5
	52.091	52.092	52.093	52.094



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.091	17.092	17.093	17.094

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	14.091/D	14.092/D	14.093/D	14.094/D
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*				

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.091	14.092	14.093	14.094




TITANBASEN

		3.25/3.75	4.1	4.5	5.5
GH 0,7mm	○			15.091*	15.094*
GH 0,9mm	○		15.091*		
GH 1,1mm	○	15.091*			
GH 0,7mm	⬡			16.091*	16.094*
GH 0,9mm	⬡		16.091*		
GH 1,1mm	⬡	16.091*			



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

	19.091*	19.091*	19.091*	19.091*
TiN	19.691*	19.691*	19.691*	19.691*
Empfohlenes Drehmoment	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*	*30 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.091*	61.092*	61.093*	61.094*
Ø 14mm	Ti				62.094*
Ø 14mm	CoCr				71.094*

CONIC BIO

kompatibel mit

Biotech KONTACT®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	NP	RP
52.078		



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.078

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.078/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

14.078



TITANBASEN

		NP	RP
	○	15.078*	
	⬡	16.078*	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

	NP	RP	
	19.078*	19.063*	19.064*
TiN	19.678*	19.663*	19.664*
Empfohlenes Drehmoment	*20 Ncm*	*20 Ncm*	*20 Ncm*



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.078*

INTERNAL BT

ohne Rotationsschutz

mit Rotationsschutz

kompatibel mit

BTI®



SCAN ABUTMENTS

	4.1	MULTI IM®
	52.079	



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.079

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.079/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

4.1	MULTI IM®
14.079	



TITANBASEN

○	15.079*
◇	16.079*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	◇	33.001-P5



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

	19.079*	19.065
TiN	19.679*	19.665*
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*10 Ncm*

EXTERNAL HEX PH

kompatibel mit

PHIBO® TSH®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	NP	SP	WP
	S2	S3-S4	S5
	52.030	52.031	52.032



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.030	17.031	17.032

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.030/D	14.031/D	14.032/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	14.030	14.031	14.032



ANGLEBase®

		NP	SP	WP
		S2	S3-S4	S5
○		36.030*	36.031*	36.032*
○		36.030/2*	36.031/2*	36.032/2*
○		36.030/3*	36.031/3*	36.032/3*
⬡		37.030*	37.031*	37.032*
⬡		37.030/2*	37.031/2*	37.032/2*
⬡		37.030/3*	37.031/3*	37.032/3*

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.403*	19.402	19.402
Empfohlenes Drehmoment	*35 Ncm*	*35 Ncm*	*35 Ncm*

Torx® BALL SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

MULTI-UNIT CONNECTION

○ ohne Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

		RP MULTI-UNIT 4.8	WP 6
Uni Grip	○	20.100	20.054
Hex 1,20mm	○	20.100H120	
Hex 1,22mm	○	20.100H122	
Hex 1,27mm	○	20.100H127	
Torx® Ball	○	20.100TB*	



SCAN ABUTMENTS

	50.007	
	52.007	52.047

EXTISA Extender für 52.xxx.

52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

		17.007	17.050
5,0mm		17.507	
5,0mm	4 Pack.	17.507-P4	
8,0mm		17.807	
8,0mm	4 Pack.	17.807-P4	



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE


	RP MULTI-UNIT 4.8	WP 6
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.007/D	14.047/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*



Plattform Farbkodierung







LABORANALOGE

	RP MULTI-UNIT 4.8	WP 6
	14.007	14.047
10 Pack.	14.007-P10	

PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

Uni Grip	○	24.007	24.030
Hex 1,20mm	○	24.007H120 *19.055*	
Hex 1,22mm	○	24.007H122 *19.065*	
Hex 1,27mm	○	24.007H127 *19.110*	
Torx®	○	24.007TB* *19.306*	

PROVISORISCHE PEEK TITANABUTMENTS

Uni Grip	○	25.707	25.754
Hex 1,20mm	○	24.757* *19.055*	
Hex 1,22mm	○	24.767* *19.065*	
Hex 1,27mm	○	24.777* *19.110*	
Torx®	○	24.787* *19.306*	

TITANBASEN

6,0mm	Uni Grip	○	15.007	15.054
6,0mm	Uni Grip	○	15.007-P10	
6,0mm	Hex 1,20mm	○	15.007H120 *19.055*	
6,0mm	Hex 1,22mm	○	15.007H122 *19.065*	
6,0mm	Hex 1,27mm	○	15.007H127 *19.110*	
6,0mm	Torx®	○	15.007TB* *19.306*	
8,0mm	Uni Grip	○	15.007/8	



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.007-P5	32.054-P5
5 Pack.	○	32.007/8-P5	



ANGLEBase®

		RP MULTI-UNIT 4.8	WP MULTI-UNIT 6
	○	36.007	36.054
10 Pack.	○	36.007-P10	

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.700-P5
5 Pack.	10°	33.701-P5
5 Pack.	20°	33.702-P5



Torx® ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

	RP	WP
(Ersatzschraube)	19.306	19.331*
Empfohlenes Drehmoment	*15 Ncm*	*15 Ncm*




Torx® BALL SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

SCREWS FOR SUPERSTRUCTURES





10 Pack.		Torx®	19.069-P10
10 Pack.	DLC	Torx®	19.269-P10
10 Pack.		Hex 1,20mm	19.093-P10
10 Pack.		Hex 1,22mm	19.094-P10
10 Pack.		Hex 1,27mm	19.095-P10
10 Pack.		UG	19.096-P10
Empfohlenes Drehmoment			*20 Ncm*



ABUTMENTSCHRAUBEN UG

			RP MULTI-UNIT 4.8	WP MULTI-UNIT 6
			19.006	19.031
10 Pack.			19.006-P10	
DLC			19.206	19.231
TiN			19.606*	19.631*
		Hex 1,20mm	19.055	
		Hex 1,22mm	19.065	
		Hex 1,27mm	19.110	
Empfohlenes Drehmoment			*15 Ncm*	*15 Ncm*

DESSLoc®

	88.007







KOBALT-CHROM-BASEN

6,0mm	○		30.007	30.054
6,0mm	○	Hex 1,20mm	30.007H120* *19.055*	
6,0mm	○	Hex 1,22mm	30.007H122* *19.065*	
6,0mm	○	Hex 1,27mm	30.007H127* *19.110*	
6,0mm	○	Torx®	30.007TB* *19.306*	
Für Webetechniken			30.107*	

KUNSTSTOFFZYLINDER

	○	28.007	28.054
10 Pack.	○	11.007-P10	11.054-P10

DESSLoc®



SCAN ABUTMENTS

	10 Pack.	53.153-P10



ABFORMPFOSTEN

	17.054



DIGITAL LABORANALOGE

	Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm*	14.054/D

**Andere Schrauben verfügbar, siehe Seite 159*

Plattform Farbkodierung



LABORANALOGE

		14.054
	10 Pack.	14.054-P10

Plattform Farbkodierung




BAR ATTACHMENT

	88.100



LABORSETS

0° - 20°	x1	DLRK-P1* DLRKL-P1
0° - 20°	x2	DLRK-P2* DLRKL-P2
0° - 40°	x1	DLER-P1* DLERL-P1
0° - 40°	x2	DLER-P2* DLERL-P2

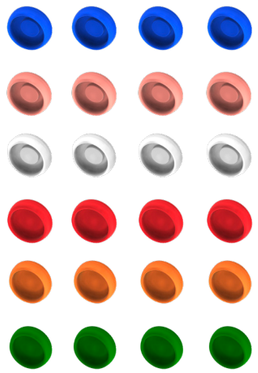

RETENSIONSEINSÄTZE

0° - 20°	x4	1.5 lbs / 680g	DLN2-P4* DLN2L-P4
0° - 20°	x4	3.0 lbs / 1360g	DLN3-P4* DLN3L-P4
0° - 20°	x4	5.0 lbs / 2270g	DLN4-P4* DLN4L-P4
0° - 40°	x4	1.5 lbs / 450g	DLN1-P4* DLN1L-P4
0° - 40°	x4	2.0 lbs / 910g	DLN6-P4* DLN6L-P4
0° - 40°	x4	4.0 lbs / 1810g	DLN7-P4* DLN7L-P4



WERKZEUGE

Direkt zum Nobel Biocare™ Drehmomentschlüssel	DTACTLOC
Direkt zum Straumann® Drehmomentschlüssel	DTSTRLOC
DESSLoc®	DTLOC
Adapter für Straumann® Drehmomentschlüssel auf Vierkantanschluss	DTSTSQ
Adapter für Nobel Biocare™ 8mm auf Vierkantanschluss	DTNBSQ

**IN USA NICHT ERHÄLTLICH*

DESS CLEAN FIT

DESS CLEAN FIT


	1x Entnahmemechanismus (inkl. Entnahmestift) 3x Sicherungskappen	1611
	2x Entnahmemechanismus (einschließlich Entnahmestift) 2x Haltekappen	1611A
	2x Haltekappen	1611B
	1x Entnahmestift	1611C

DESS CLEAN FIT Abutments

Festsitzend und dennoch herausnehmbar
Das Beste aus beiden Welten



- Fühlt sich an wie eine festsitzende Versorgung.
- Friktionspassung, einfach herauszunehmen.
- Keine Kunststoffeinsätze.
- Kein Knochenverlust.*
- periocoat® Oberflächentechnologie mit der patentierten ZrN-Beschichtung von DESS.
- Patentierte Matrizen mit Entriegelungssystem.
- Kompatibel mit dem Atlantis® Konus-Konzept und Syncone®.

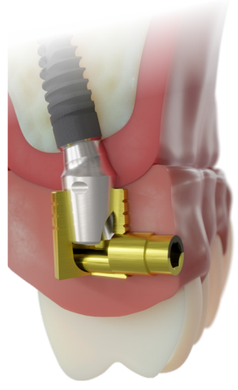



*Im Vergleich zu herausnehmbaren Standardprothesen.



PURE SWITCH *by* DESS®

"simple switch, perfect connection"

Alle DESS® -Produkte basieren auf der "Pure Switch"-Philosophie, einem Konzept, das die Austauschbarkeit von Abutments garantiert, ohne dass Werkzeuge oder Protokolle geändert werden müssen.

Diese Philosophie gewährleistet, dass alle DESS® -Abutments mit jedem Abutment einer anderen Implantatmarke austauschbar sind.

- Garantierte Qualität.

ISO 9001 ISO 13485 · CE 051 · Health Canada Medical Device Licenses 94512 & 107023 · FDA

- Lebenslange Garantie[1].
- 100%ige Kompatibilität.
- CAD/CAM-Bibliotheken verfügbar.
- Mehr als 30 Verbindungen von einem einzigen Anbieter.

[1]Um mehr über die lebenslange DESS-Garantie zu erfahren, laden Sie sie auf unserer Website herunter.

HALTER



HLDSTD

Für Standard 98mm Discmaschinen

Jede Maschine mit 98mm Disk Halter



HLDIMES

Für Imes-Icore® Maschinen

Coritec 150i pro
Coritec 245i touch
Coritec 250i touch
Coritec 350i / Coritec 250i Loader
Coritec 450i
Coritec 550i
Coritec 650i / Coritec 650i Loader



HLDVHF

Für VHF®

VHF® S1
VHF® S2
VHF® K5



HLDVHFR5

Für VHF®

VHF® R5

HLDYENA

Für Yenadent®

D6
D15
D43N



HLDVHFN4

Für VHF®

VHF® N4



HLDVHFZ4

Für VHF®

VHF® Z4



HLD3R

Für Maschinen mit Support / Wechsler 3R

D14P




AK-1 ROLAND

DESS-Pre-mills sind kompatibel mit AK-1 Halter, entwickelt und geliefert von ROLAND.

AURUM FRÄSWERKZEUG



	ØA	ØB	ØC	L1	L2	L3	R
MT3D16L5	3	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1
MT4D16L5	4	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1
MT6D16L5	6	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1

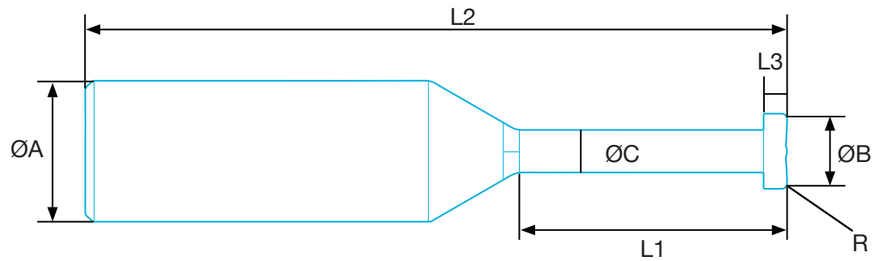

VORGEFRÄSTE BLÖCKE




Ti	□15mm	L 20mm	63.020
Ti	□15mm	L 40mm	63.040
CoCr	□15mm	L 20mm	73.020
CoCr	□15mm	L 40mm	73.040

WERKZEUGE

SCHRAUBENDREHER SPITZE

HEX	18mm	20mm	24mm	30mm	35mm	kompatibel mit
0,90mm		DTC20H090	DTC24H090			Neodent® CM
1,00mm		DTC20H100	DTC24H100		DTC35H100	Dentsply Ankylos® C/X
1,20mm	DTC18H120	DTC20H120	DTC24H120	DTC30H120	DTC35H120	3i Osseotite®, Neodent® CM & GM, 3iCertain®, Megagen AnyRidge®
1,22mm		DTC20H122	DTC24H122		DTC35H122	Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTI®, Biotech Kontact®
1,25mm		DTC20H125	DTC24H125			
1,27mm		DTC20H127	DTC24H127	DTC30H127	DTC35H127	Astra tech™, OsseosSpeed™, Zimmer Screw-Vent® & Mis® Seven/ C1 & V3, BioHorizons®, AstraTech Implants System EV™, Camlog®, Bego Semados®, Conelog®
1,30mm		DTC20H130	DTC24H130			
1,50mm		DTC20H150	DTC24H150			
1,70mm		DTC20H170	DTC24H170			
1,75mm		DTC20H175	DTC24H175			Astra tech™, OsseosSpeed™, Uniabutment®




Torx® 06



DT20TC06	DT24TC06	DT30TC06	DT35TC06	Straumann® Soft Tissue Level & synOcta® Straumann® Bone Level


Torx® ball



DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06	ANGLEBase®, ELLIPTIBase®

UG

18mm	20mm	24mm	30mm	35mm	
	DT20U	DT24U	DT30U	DT35U	Nobel Brånemark®, NobelReplace® Select™, NobelActive™ & NobelReplace® CC, Multi-unit®




NEO

18mm	20mm	24mm	30mm	35mm	kompatibel mit
		DT24NG	DT30NG	DT35NG	Grand Morse® Neodent®



Cuadrado

1,30mm		DT20S130	DT24S130		



SCHRAUBENDREHERGRIFFE





ZAHNARZTGRIFF	21mm Straumann® Ratsche ø7mm	21mm Nobel® Ratsche ø8mm	28mm Straumann® Ratsche ø7mm	28mm Nobel® Ratsche ø8mm
HEX 1,20mm	WSDSTL21H120	WSDNBL21H120	WSDSTL28H120	WSDNBL28H120
HEX 1,25mm	WSDSTL21H125	WSDNBL21H125	WSDSTL28H125	WSDNBL28H125
UG	WSDSTL21UG	WSDNBL21UG	WSDSTL28UG	WSDNBL28UG
Torx® 06	WSDSTL21TC06	WSDNBL21TC06	WSDSTL28TC06	WSDNBL28TC06
Torx® ball	WSDSTL21TB06	WSDNBL21TB06	WSDSTL28TB06	WSDNBL28TB06

HOCHWERTIGER LABORGRIFF



PHLABGOLD

PHLABBLACK

DESSLoc® ENTNAHME - UND EINSETZWERKZEUG



PHLOC

TITANBASEN AUSZIEHWERKZEUG

	Für Conelog® NP/RP	DCCON
	Für Conelog® WP	DCCON50
	Für ZIMMER Screw-vent®	DCZIM
	Für Medentis ICX®	DCICX


DREHMOMENTSCHLÜSSEL

	Typ Straumann 7mm	DTSTTW
	Typ Nobel 8mm	DTNBTW

MEHRZWECKBOX

		BOX1

SPEZIELLE WERKZEUGE

	Multi-unit® RP	DTMURP
	Multi-unit® WP	DTMUWP
	UniAbutment® (Astra Tech osseospeed™)	DTUNI
	Octagon	DTSYN
	Drehmomentschlüssel Adapter	TWADAP
	DESSLoc®	DTLOC
	Adapter für Straumann® Drehmomentschlüssel auf Vierkantanschluss	DTSTSQ
	Straumann® adapter von 7mm auf Vierkantanschluss	DTSTWH
	Direkt zum Nobel Biocare™ Drehmomentschlüssel	DTACTLOC
	Direkt zum Straumann® Drehmomentschlüssel	DTSTRLOC
	Adapter für Schraubendrehereinsätze von Straumann® Drehmomentschlüsseln	DTSTCA
	Nobel Biocare™ Winkelstück-Adapter	DTNBSQ
	Adapter für Schraubendrehereinsätze von Nobel Biocare™ Drehmomentschlüssel	DTNBWH
	Nobel Biocare™ Winkelstück-Adapter	DTNBCA
	Handstückadapter für Winkelanschluss	DTANGSQ
	Manueller Treiber für Intraorale Scan-Abutments	DTPEI
	Manueller Treiber für Intraorale Scan-Abutments	DTPEIPEEK-P2

SCHRAUBE FÜR STRUKTUREN

Nobel Brånemark® External Hex Universal	NP/3.5 Screw UG	Für Strukturen	19.101 19.101-P10 *Pack of 10*
Straumann® Soft Tissue Level & SynOcta® Octagon	RN/WN Screw TORX®	Für Strukturen auf Implantat	19.102 19.102-P10 *Pack of 10*
Straumann® Soft Tissue Level & SynOcta® Octagon	RN/WN Screw TORX®	Für Strukturen auf abutment	19.103 19.103-P10 *Pack of 10*
Straumann® Bone Level Conical BL	NC/RC Screw TORX®	Für Strukturen	19.104 19.104-P10 *Pack of 10*
Straumann® Bone Level Conical BL	NC/RC Screw TORX®	Für Strukturen auf Multi-Base	19.105 19.105-P10 *Pack of 10*
MULTI-UNIT 3i	Multi-Unit connection Sxrew Hex 1,20	For 3I	19.106 19.106-P10 *Pack of 10*
Dentsply ANKYLOS® C/X Internal ANK	Sxrew Hex 1,00	Für Strukturen auf abutment	19.349







MULTI-UNIT	RP/4.8 Screw Torx®	Für Strukturen	19.069-P10 *Pack of 10* 19.269-P10 *DLC Pack of 10*
MULTI-UNIT	RP/4.8 Hex 1,20mm	Für Strukturen	19.093-P10 *Pack of 10*
MULTI-UNIT	RP/4.8 Hex 1,22mm	Für Strukturen	19.094-P10 *Pack of 10*
MULTI-UNIT	RP/4.8 Hex 1,27mm	Für Strukturen	19.095-P10 *Pack of 10*
MULTI-UNIT	RP/4.8 Screw UG	Für Strukturen	19.096-P10 *Pack of 10*

DESS® DESIGN:

FLACHSITZ VORTEILE

- Ermöglicht eine höhere Vorspannung/Spannkraft zwischen der Prothese und dem MUA.
- Besitzt eine höhere Toleranz gegenüber Ungenauigkeiten beim Fräsen des Schraubensitzes.
- Version mit DLC-Beschichtung erhältlich für reduzierte Reibung und zusätzlich verbesserte Vorspannung/Spannkraft.
- Die Schraubenlänge gestattet mehr Prothetikmaterial unter dem Schraubensitz und sorgt somit für eine verbesserte Festigkeit sowohl von Zirkondioxid- als auch von provisorischen Versorgungen.
- Die selbstzentrierende Flachsitz-Schraube besitzt eine höhere Toleranz, um Divergenzen zwischen den Längsachsen der Versorgung und des MUA auszugleichen.
- Die Torx-Verbindung ist mit dem DESS® Torx® Kugelkopf-Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle kompatibel.





SCHRAUBEN
EMPFOHLENE DREHMOMENTE

NOBELACTIVE® & NOBELREPLACE® CC
ACTIVE HEX



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
3.0	19.068	15	Nobel Biocare® 36805
3.0	19.268*	15	Nobel Biocare® 37890
3.0	19.668*	15	
NP	19.027	35	Nobel Biocare® 31168
NP	19.227	35	Nobel Biocare® 29282
NP	19.101	35	
NP	19.327	35	
NP	19.627*	35	
NP ANGLEBase®	19.441	35	
RP	19.030	35	Nobel Biocare® 28815
RP	19.230	35	Nobel Biocare® 36918
RP	19.328	35	
RP	19.630*	35	
RP ANGLEBase®	19.442	35	
On1®	19.021	35	Nobel Biocare® 38751
On1®	19.221	35	Nobel Biocare® 38750
On1®	19.621*	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.507	35	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.508	35	

NOBELREPLACE SELECT™
TRI-LOBE



NP	19.004	35	Nobel Biocare® 31170
NP	19.204	35	Nobel Biocare® 36818
NP	19.304	35	
NP	19.604*	35	
NP ANGLEBase®	19.404	35	
RP/WP/6.0	19.005	35	Nobel Biocare® 29293
RP/WP/6.0	19.205	35	Nobel Biocare® 29475
RP/WP/6.0	19.305	35	
RP/WP/6.0	19.605*	35	
RP/WP ANGLEBase®	19.405	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.504	35	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.505	35	

NOBEL BRÅNEMARK®
EXT HEX UNIVERSAL



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
NP	19.027	35	Nobel Biocare® 31168
NP	19.227	35	Nobel Biocare® 29282
NP	19.327	35	
NP	19.101	35	
NP	19.627*	35	
NP ANGLEBase®	19.401	35	
RP	19.028	35	Nobel Biocare® 29290
RP	19.228	35	Nobel Biocare® 29283
RP	19.328	35	
RP	19.628*	35	
RP ANGLEBase®	19.402	35	
WP	19.029	35	Nobel Biocare® 31169
WP	19.229	35	Nobel Biocare® 29284
WP	19.329	35	
WP	19.629*	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.501	35	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.502	35	

3i CERTAIN®
EXT HEX USA



NP/RP/WP	19.034	20	Biomet 3i® UNIHT
NP/RP/WP	19.634	20	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.402	20	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.512	20	
Low Profile® Abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH

3i OSSEOTITE®
INT HEX CLICK



NP/RP/WP	19.011	20	Biomet 3i® IUNIHT
NP/RP/WP	19.311	20	
NP/RP/WP	19.611	20	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.438	20	
Low Profile® Abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH

STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL & SynOcta®
OCTAGON



NNC	19.070	35	Straumann® AG 048.314
NNC	19.670	35	
RN/WN auf implantat	19.026	35	Straumann® AG 048.356
RN/WN auf implantat	19.102	35	Straumann® AG 049.181
RN/WN auf implantat	19.328	35	
RN/WN auf implantat	19.626*	35	
RN/WN ANGLEBase®	19.446	35	
RN/WN auf synOcta® abutment	19.009	15	Straumann® AG 048.350
RN/WN auf synOcta® abutment	19.103*	15	
RN/WN auf synOcta® abutment	19.609*	15	

STRAUMANN® BONE LEVEL
CONICAL BL



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
NC auf implantat	19.032	35	Straumann® AG 025.2908
NC auf implantat	19.632*	35	
RC auf implantat	19.033	35	Straumann® AG 025.4908
RC auf implantat	19.633*	35	
NC/RC auf implantat	19.037	35	Straumann® AG 025.4900
NC/RC auf implantat	19.104	35	Straumann® AG 025.4906
NC/RC auf implantat	19.311	20	
NC/RC ANGLEBase®	19.443	35	
NC/RC auf implantat for Multi-unit®	19.544	35	
NC/RC auf Multi-base® abutment	19.041	15	Straumann® AG 025.0900-04
NC/RC auf Multi-base® abutment	19.105	15	
NC/RC auf SRA® abutment	19.098*	15	Straumann® AG 023.4763

STRAUMANN® BLX
CONICAL BLX



RB/WB	19.054	35	
RB/WB	19.700*	35	
RB/WB ANGLEBase®	19.441	35	

NEODENT® GRAND MORSE®
NEO GM



GM	19.051	20	
GM ANGLEBase®	19.444	20	

ZIMMER SCREW-VENT®
INT HEX USA



NP/RP/WP	19.012	30	Zimmer® URS2
NP/RP/WP	19.012L*	30	
NP/RP/WP	19.042	30	Zimmer® MHLAS
NP/RP/WP	19.642*	30	
NP/RP/WP	19.312	30	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.417	30	
NP (MIS®)	19.327	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.519	30	
RP auf Multi-unit® abutment ø4.8	19.110	15	
RP auf Multi-unit® abutment ø4.8	19.300	15	

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV
CONIC EVO



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
3.6 auf implant	19.059*	25	
3.6 auf implant	19.659*	25	
3.6 ANGLEBase®	19.441	25	
4.2 auf implantat	19.060*	25	
4.2 auf implantat	19.660*	25	Astra Tech® 25.205
4.2 ANGLEBase®	19.460	25	
4.8 auf implantat	19.061*	25	
4.8 auf implantat	19.661*	25	
4.8 ANGLEBase®	19.461	25	
UniAbutment® EV	19.058	15	
UniAbutment® EV	19.658*	15	

ASTRA TECH OSSEOSPEED™
INT HEX CONIC



NP auf implantat	19.015	15	Dentsply® 24189
NP auf implantat	19.615*	15	
RP auf implantat	19.016	20	Dentsply® 24449
RP auf implantat	19.616*	20	
RP ANGLEBase®	19.441	20	
WP auf implantat	19.017	25	Dentsply® 24209
WP auf implantat	19.617*	25	
WP ANGLEBase®	19.425	25	
UniAbutment® 20º/45º	19.018	15	Dentsply® 22435
UniAbutment® 20º/45º	19.618*	15	

DENTSPLY FRIADENT XIVE®
INT HEX FD



NP/RP/WP	19.024	24	Dentsply® 454305
NP/RP/WP	19.624*	24	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.438	24	

DENTSPLY ANKYLOS® C/X
INT ANK



Alle Plattformen	19.048	15	
Alle Plattformen	19.050	15	
Alle Plattformen	19.648*	15	

	PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
OSSTEM® TS CONIC OSS	Mini auf implantat	19.072	20	
	Mini auf implantat	19.672*	20	
	Mini ANGLEBase®	19.444	20	
	Standard auf implantat	19.073	30	Osstem® GSABSST
	Standard auf implantat	19.673*	30	
	Standard ANGLEBase®	19.461	30	
CAMLOG® INT CAM	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.044	20	
	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.644*	20	Camlog® J4005. 1601
	3,8 / 4,3 ANGLEBase®	19.444	20	
	5.0 auf implantat	19.045	20	Camlog® J4005. 2001
	5.0 auf implantat	19.645*	20	
CONELOG® INT CON	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.074*	20	Camlog® C4005. 1601
	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.674*	20	
	5.0 auf implantat	19.076*	20	Camlog® C4005. 2001
	5.0 auf implantat	19.676*	20	
BIOHORIZONS® INTERNAL INT HEX BH	Auf implantat	19.043	30	BioHorizons® PXAS
	Auf implantat	19.043	30	
	Multi-unit® RP ø4.8	19.006	15	Nobel Biocare® 29287
	Low Profile® abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH
	Multi-unit® RP ø4.8	19.110	15	
	Multi-unit® RP ø4.8	19.206	15	Nobel Biocare® 29285
	Multi-unit® RP ø4.8 ANGLEBase®	19.306	15	
	Multi-unit® RP ø4.8	19.606	15	
	MIS® Multi-unit® RP ø4.8	19.300	15	
	Multi-unit® WP ø6.0	19.031	15	Nobel Biocare® 31163
	Multi-unit® WP ø6.0	19.231	15	Nobel Biocare® 29286
	Multi-unit® WP ø6.0 ANGLEBase®	19.331	15	
	Multi-unit® WP ø6.0	19.631	15	

	PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
BIOHORIZONS® EXTERNAL EXT HEX BH	NP	19.013*	30	BioHorizons® 130-050
	NP	19.312	30	
	RP/WP	19.014*	30	BioHorizons® 140-050
	RP/WP	19.328	35	
MIS® SEVEN INT HEX MI	NP	19.056	30	
	NP	19.656*	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	19.081	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	19.681	30	
	SP/WP ANGLEBase®	19.417	30	
	Multi-unit® MIS®	19.085	25	
	Multi-unit® MIS®	19.685	25	MIS® MU-S0220
MIS® C1 CONIC MC	NP	19.056	30	
	NP	19.656	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	19.081	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	19.681	30	
	Multi-unit® MIS®	19.085	25	
	Multi-unit® MIS®	19.685	25	MIS® MU-S0220
MIS® V3 CONIC MV	NP	19.056	30	
	NP	19.656	30	MIS® MN-S0160
	SP	19.081	30	MIS® MD-S0220
	SP	19.681	30	
	Multi-unit® MIS®	19.085	25	
	Multi-unit® MIS®	19.685	25	MIS® MU-S0220
MEGAGEN AnyRidge® CONIC ANYR	Alle plattformen	19.057	35	
	Alle plattformen	19.657*	35	Megagen® AANMSF
	Alle plattformen ANGLEBase®	19.460	35	

Anthogyr AXIOM® BL
CONIC AXIO



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
Auf implantat	19.077*	25	Anthogyr® OPTS161
Auf implantat	19.677*	25	
Multi-unit® abutment	19.062*	15	
Multi-unit® abutment	19.662*	15	

MEDENTIS ICX®
CONIC IC



Auf implantat	19.080*	30	Medentis® C-007-000001-01
Auf implantat	19.680*	30	
Auf implantatt ANGLEBase® H2.2	19.444	30	
Auf implantat ANGLEBase® H0.9	19.443	30	

GLOBALD IN-KONE®
CONIC INK



Auf implantat	19.086*	15	GlobalD® DVPCI
Auf implantat	19.686*	15	
Konisches Abutment Geradeaus weiter	19.035*	15	GlobalD® DVPIINK
Konisches Abutment Geradeaus weiter	19.635	15	
Conical abutment Abgewinkelt	19.036*	15	
Conical abutment Abgewinkelt	19.636	15	

DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM®
CONIC DENT



Auf implantat	19.090*	30	Dentium® ASC 2045
Auf implantat	19.690*	30	
Auf implantat	19.066*	10	Dentium® SRS 18T
Auf implantat	19.666*	10	

BEGO SEMADOS®
INTERNAL SEM



Auf implantat	19.091	30	Bego® 57.031
Auf implantat	19.691	30	

BIOTECH KONTACT®
CONIC BIO



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. Nº	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. Nº
Auf implantat	19.078*	20	Biotech® KVP
Auf implantat	19.678*	20	
Konisches Sekundärteil Schmal	19.063*	20	
Konisches Sekundärteil Schmal	19.663*	20	
Konisches Abutment Stundard	19.064*	20	Biotech® KECGMV
Konisches Abutment Stundard	19.664*	20	

BTI®
INTERNAL BT



Auf implantat	19.079*	35	
Auf implantat	19.679*	35	
Multi IM®	19.065	10	
Multi IM®	19.665*	10	

PHIBO® TSH®
EXTERNAL HEX PH



NP ANGLEBase®	19.403	35	
SP/WP ANGLEBase®	19.402	35	

MULTI-UNIT



NP	19.006	15	
NP	19.206	15	
NP	19.606*	15	
WP	19.031	15	
WP	19.231	15	
WP	19.631*	15	
RP ANGLEBase®	19.306	15	
WP ANGLEBase®	19.631*	15	

FESTSTELLSCHRAUBEN FÜR DIGITAL-ANALOG



HEX 1,00	19.707-P5	HEX 1,28	19.713-P5
HEX 1,18	19.708-P5	HEX 1,40	19.714-P5
HEX 1,20	19.709-P5	Unigrip®	19.715-P5
HEX 1,22	19.710-P5	Torx®	19.716-P5
HEX 1,25	19.711-P5	NE	19.717-P5
HEX 1,27	19.712-P5		


DESS
DENTAL SMART SOLUTIONS

DESS
DENTAL SMART SOLUTIONS

Alle DESS-Produkte werden gemäß ISO 9001 und ISO 13485 mit CE-Kennzeichnung
für alle Produkte der Klasse IIb, IIa hergestellt.
Alle DESS® ANGLEBase® Schrauben und Schraubendreher basieren auf der Norm ISO 10664
3i® und 3i Certain®, Miniplant®, MicroMiniplantTM und Osseotite® sind
eingetragene Warenzeichen von 3i Implant Innovations, USA
ASTRA TECHTM, OsseoSpeedTM, ANKYLOS® C/X, XiVE®, FRIADENT®,
ASTRATECH Implantat systemTM EV und UniAbutment® Cerec®
sind eingetragene Marken von DENTSPLY SIRONA Implants
BioHorizons® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BioHorizons, INC.
Brånemark System®, NobelReplace® und Replace® SelectTM, NobelActiveTM, NobelReplace® CC, NobelSpeedy™ und
Multi-unit® sind eingetragene Marken von Nobel Biocare AB,
Neodent®, Grand Morse®, Straumann® und synOcta® sind eingetragene Marken der Straumann Holding AG, Schweiz.
MIS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von MIS Implant Technologies Ltd.
Zimmer Screw-Vent® und SwissPlus® sind eingetragene Warenzeichen von Zimmer Dental INC, USA
Dyna® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dyna Dental Engineering BV
Locator® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ZEST IP Holdings
Camlog® und Conelog® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies AG
Megagen® ist ein eingetragenes Warenzeichen von MEGAGEN IMPLANT CO. LTD
TORX® ist ein Warenzeichen von ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC
Bego Semados® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BEGO GmbH & Co. KG
Anthogyr® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Anthogyr SAS
Medentis ICX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der medentis medical GmbH
Osstem®, Hiossen® ist ein eingetragenes Warenzeichen von OSSTEM IMPLANT CO. LTD
Dentium® ist ein Warenzeichen von Dentium Co. Ltd.
GOBALD® ist ein Warenzeichen von Global D SASU.
Biotech Kontact® ist ein Warenzeichen von Biotech Dental SAS.
BTI® ist eine Marke des BTI Biotechnology Institute.
PHIBO® ist eine Marke des PHIBO Dental Solutions S.L.

DESS-Produkte können nur von zugelassenen Zahnärzten, Ärzten und Laboren verwendet werden.
Bitte beachten Sie immer die Gebrauchsanweisung auf der Website:

www.dessdental.com

oder mit dem Produkt geliefert.

Einige Produkte sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar.

CE 0051 IQNet ISO 9001 ISO 13485 MDSAP MEDICAL DEVICE SINGLE AUDIT PROGRAM Health Canada Medical Device Licenses 94512 & 107023 FDA



www.dessdental.com